

anbai  Instruments

常州安柏精密仪器有限公司

江苏省常州市钟楼区宝龙 61-3 层

电话：0519-88805550

传真：0519-83288327

<http://www.applent.com>

销售服务电子邮件: sales@applent.com

技术支持电子邮件: tech@applent.com

©2005-2016 Applent Instruments, Inc.

Rev.A0

固件说明：

适用于主程序 RevA1.0 及以上的版本。

[AT4108/4116 多路温度测试仪]

用户手册

声明

根据国际版权法，未经常州安柏精密仪器有限公司 (Applent Instruments Inc.) 事先允许和书面同意，不得以任何形式复制本文内容。

安全信息

 **警告**  **危险**：为避免可能的电击和人身安全，请遵循以下指南进行操作。

免责声明

用户在开始使用仪器前请仔细阅读以下安全信息，对于用户由于未遵守下列条款而造成的人身安全和财产损失，安柏仪器将不承担任何责任。

仪器接地

为防止电击危险，请连接好电源地线。

不可 在爆炸性气体环境使用仪器

不可在易燃易爆气体、蒸汽或多灰尘的环境下使用仪器。在此类环境使用任何电子设备，都是对人身安全的冒险。

不可 打开仪器外壳

非专业维护人员不可打开仪器外壳，以试图维修仪器。仪器在关机后一段时间内仍存在未释放干净的电荷，这可能对人身造成电击危险。

不要 使用工作异常的仪器

如果仪器工作不正常，其危险不可预知，请断开电源线，不可再使用，也不要试图自行维修。

不要 超出本说明书指定的方式使用 仪器

超出范围，仪器所提供的保护措施将失效。



安全标志：



设备由双重绝缘或加强绝缘保护

废弃电气和电子设备 (WEEE) 指令 2002/96/EC



切勿丢弃在垃圾桶内

声明：

anbai, , , 安柏 标志和文字是常州安柏精密仪器有限公司商标或注册商标。

AT4108/4116

用户手册

User's Manual

简体中文

Simplified Chinese

Rev.A0 2015/5



常州安柏精密仪器有限公司

©2005-2009 Applent Instruments, Inc.

有限担保和责任范围

常州安柏精密仪器有限公司 (以下简称 Applent) 保证您购买的每一台 AT4108/4116 在质量和计量上都是完全合格的。此项保证不包括保险丝以及因疏忽、误用、污染、意外或非正常状况使用造成的损坏。本项保证仅适用于原购买者, 并且不可转让。

自发货之日起, Applent 提供玖拾 (90) 天保换和贰年免费保修, 此保证也包括 VFD 或 LCD。玖拾天保换期内由于使用者操作不当引起的损坏, 保换条款终止。贰年保修期内由于使用者操作不当而引起仪器损坏, 维修费用由用户承担。贰年后直到仪表终生, Applent 将以收费方式提供维修。对于 VFD 或 LCD 的更换, 其费用以当前成本价格收取。

如发现产品损坏, 请和 Applent 取得联系以取得同意退回或更换的信息。之后请将此产品送销售商进行退换。请务必说明产品损坏原因, 并且预付邮资和到目的地的保险费。对保修期内产品的维修或更换, Applent 将负责回邮的运输费用。对非保修产品的修理, Applent 将针对维修费用进行估价, 在取得您的同意的前提下才进行维修, 由维修所产生的一切费用将由用户承担, 包括回邮的运输费用。

本项保证是 Applent 提供唯一保证, 也是对您唯一的补偿, 除此之外没有任何明示或暗示的保证 (包括保证某一特殊目的的适应性), 亦明确否认所有其它的保证。Applent 或其它代理商并没有任何口头或书面的表示, 用以建立一项保证或以任何方式扩大本保证的范围。凡因对在规格范围外的任何原因而引起的特别、间接、附带或继起的损坏、损失 (包括资料的损失), Applent 将一概不予负责。如果其中某条款与当地法规相抵触或由于某些司法不允许暗示性保证的排除或限制, 以当地法规为主, 因此该条款可能不适用于您。但该条款的裁定不影响其它条款的有效性和可执行性。


中华人民共和国
江苏省
常州安柏精密仪器有限公司
二〇〇九年十月
Rev.A1

目录

声明	2
安全信息	2
有限担保和责任范围	4
目录	5
1. 安装和设置向导	7
1.1 装箱清单	7
1.2 电源要求	7
1.3 操作环境	7
1.4 清洗	7
1.5 仪器手柄	8
2. 概述	9
2.1 引言	9
2.2 主要规格	9
2.3 主要功能	9
2.3.1 FUNCTION	9
2.3.2 分选设置	9
2.3.3 FAT 存储功能	9
2.3.4 系统设置	9
2.3.5 远程控制	10
3. 开始	11
3.1 前面板	11
4. [MEAS] 测量显示	13
4.1 <测量显示>页	13
4.1.1 测量【型号】	14
4.1.2 通道【001】	14
5. [SETUP]设置显示	15
5.1 <设置显示>页	15
5.1.1 设置【比较器】	15
5.1.2 设置【速度】	15
5.1.3 设置【讯响】	16
5.1.4 设置【单位】	16
5.2 分选设置	16
5.2.1 【001】	17
5.3 U 盘设置	17
5.3.1 【创建文件】	17
5.3.2 【记录时间】	18
5.3.3 【01】	18
6. 系统配置	19
6.1 <系统配置>页	19
6.1.1 系统【语言】	19

6.1.2	系统【日期】、【时间】	19
6.1.3	系统【账号】、【密码】	20
6.1.4	系统【波特率】	21
6.2	<系统信息>页	21
6.3	<系统服务>页	21
7.	文件配置.....	22
7.1	<文件管理>页	22
8.	远程控制.....	23
8.1	关于 RS-232C	23
8.2	关于 USB 转接器(可选)	24
8.3	选择波特率	24
8.4	SCPI 语言.....	24
9.	SCPI 命令参考.....	25
9.1	命令串解析	25
9.1.1	命令解析规则.....	25
9.1.2	符号约定和定义	25
9.1.3	命令树结构.....	25
9.1.4	命令.....	26
9.1.5	参数.....	26
9.1.6	分隔符.....	27
9.2	命令参考	27
9.2.1	MEAS 子系统.....	27
9.2.2	SYST 子系统.....	28
9.2.3	FETCH 子系统.....	29
9.2.4	ERROR 子系统.....	29
9.2.5	IDN 子系统.....	29
10.	规格.....	30
11.1	技术指标	30
11.2	规格	31
11.3	外形尺寸.....	31

1. 安装和设置向导



感谢您购买我公司的产品！使用前请仔细阅读本章。以下介绍主要均以 AT4108/4116 为例。

在本章您将了解到以下内容：

- 装箱清单
- 电源要求
- 操作环境
- 清洗
- 仪器手柄

1.1 装箱清单

正式使用仪器前请首先：

1. 检查产品的外观是否有破损、刮伤等不良现象；
2. 对照仪器装箱清单检查仪器附件是否有遗失。

如有破损或附件不足，请立即与安柏仪器销售部或销售商联系。

1.2 电源要求

AT4108/4116 系列多路温度测试仪只能在以下电源条件使用：

电压：90V-260VAC

频率：47-440Hz

功率：最大 10VA



警告：为防止电击危险，请连接好电源地线

如果用户更换了电源线，请确保该电源线的地可靠连接。

1.3 操作环境

AT4108/4116 必须在下列环境条件下使用：

温度：0°C ~ 55°C，

湿度：在 23°C 小于 70%RH

海拔高度：0~2000 米

1.4 清洗

不可清洁仪器内部。



注意：不能使用溶剂（酒精或汽油等）对仪器进行清洗。

请使用干净布蘸少许清水对外壳和面板进行清洗。

1.5 仪器手柄

仪器手柄可以调节，双手同时握住手柄两侧，向两侧轻拉，然后旋转手柄。手柄可以调节到四个位置，如下图所示：

图 1-1 仪器手柄(示意图,面板图形与实际不符)




可视位置 1 【双手同时握住手柄两侧，向两侧轻拉，直到可自由旋转为止，然后切换到可视位置 2】




手提位置

可视位置 2 【双手同时握住手柄两侧，向两侧轻拉，直到可自由旋转位置，然后切换到手提位置】

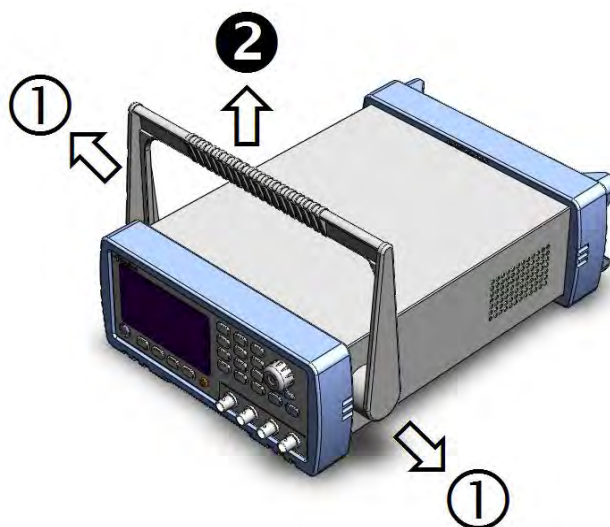

移除手柄位置。(向两侧①拉，直到移除手柄。)

2.概述



本章您将了解到以下内容：

- 引言
- 主要规格
- 主要功能

2.1 引言

感谢您购买 AT4108/4116 多路温度测试仪。

AT4108/4116 多路温度测试仪采用高性能 ARM 微处理器控制，可同时对多路温度数据进行采集，并把数据记录在 USB 存储器上，上超下超报警和通讯传输，兼容多种温度传感器，响应速度快，数据稳定，同时具备断偶检测功能。

仪器配置 RS232 接口，通过标配的计算机软件可实现数据采集，分析和打印。

支持 USB 磁盘存储器，实时存储采样数据。用户可以对每路数据进行独立校正。

2.2 主要规格

AT4108/4116 系列技术规格，包含了仪器的基本技术指标和仪器测试允许的范围。这些规格都是在仪器出厂时所能达到的。

- 分度号：热电偶 J,K,T
- 基本准确度：0.2%+1 个字
- 测试范围：-200.0℃~1800.0℃（根据不同的热电偶型号改变）
- 分辨率：0.1℃
- 通道数：8 路/16 路
- 测试速度：快速，中速，慢速
- 显示 - 采用 3.5 英寸真彩液晶

2.3 主要功能

2.3.1 FUNCTION

- 1.比较器功能设置
- 2.采样速度设置
- 3.讯响功能设置
- 4.温度单位设置

2.3.2 分选设置

内建分选数据，可对每一路温度数据进行上限和下限设置

2.3.3 FAT 存储功能

允许用户创建【.csv】为后缀的档，并把每一路的数据保存在 USB 内存里（不支持移动硬盘）。

2.3.4 系统设置


1. 键盘锁定功能
2. 中、英文切换

3. 日期和时间设置
4. 管理员和用户账户，可对管理员设置密码
5. 波特率设置

2.3.5 远程控制

支持最大 115200bps 的波特率，兼容 SCPI 协议，ASCII 传输。

3.开始



- 本章您将了解到以下内容：
- 前面板和后面板
 - 测试端的连接

3.1 前面板

图 3-1 前面板

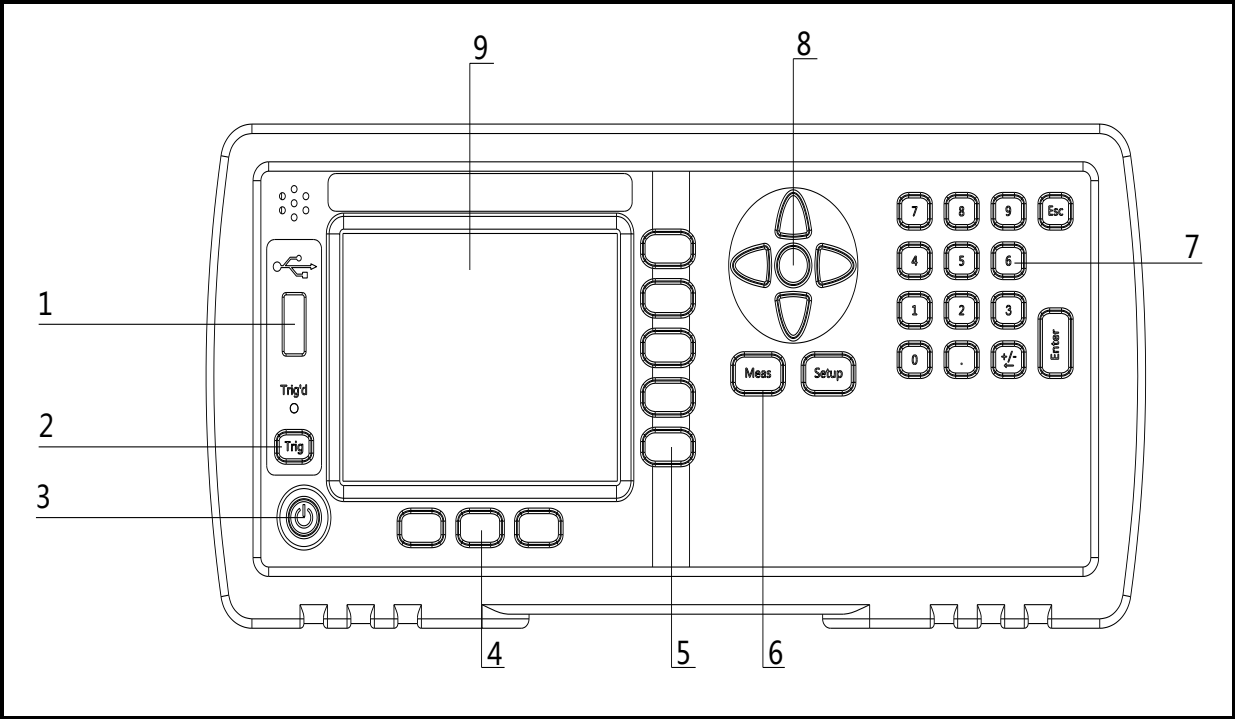


表 3-1 前面板功能描述

序号	功能
1	USB 磁盘接口（选项）
2	NG
3	电源开关。轻触式按键 ⚠ 警告：为了确保仪器的稳定工作，仪器在关机后需要等待 10 秒钟才允许再次启动。
4	系统功能键，包括文件、系统、键盘锁等
5	功能键
6	主功能键：测量和设置
7	数字键盘
8	光标键
9	液晶显示窗

图 3-2 后面板


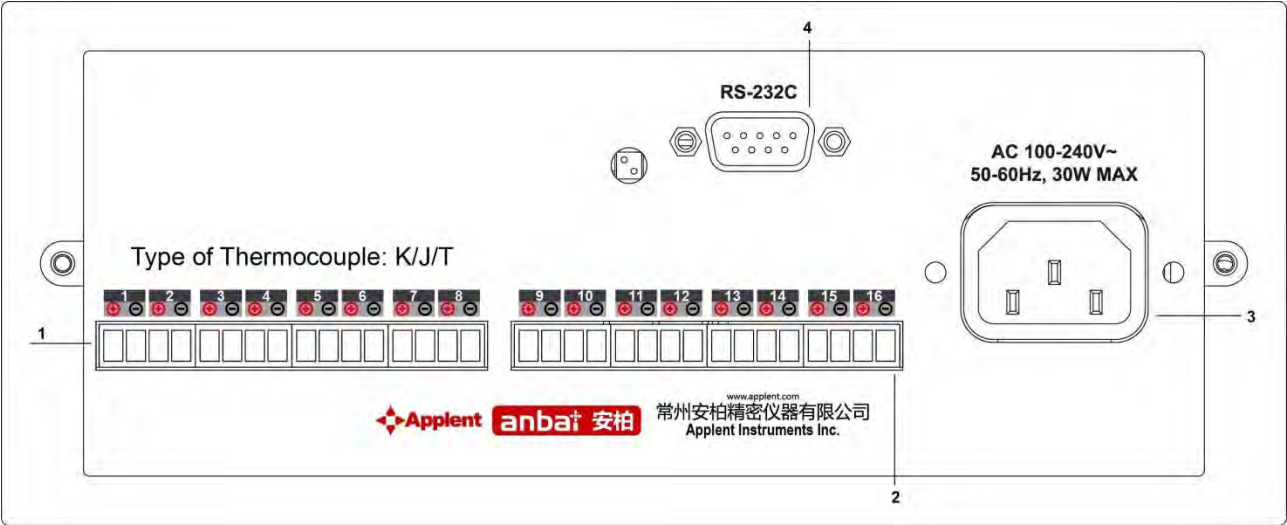


表 3-2 后面板功能描述

序号	功能
1	CH1~CH8 接线端
2	CH9~CH16 接线端
3	电源插座和保险丝盒
4	RS232 通讯接口

4.[Meas] 测量显示



本章您将了解到所有的测量显示功能：

- <测量显示>页
- <曲线显示>页
- <历史数据显示>页
- <曲线图设置>页

4.1 <测量显示> 页

无论在什么页面，您只要按【Meas】快捷键，就可以进入<测量显示>页。
<测量显示>页主要突出显示测量结果。同时对当前的分选结果改变字体颜色符显示。

该页面上可以对 1 个常用功能进行设置，它们包括：

- 型号 – 选择热电偶型号
- 001 – 通道设置

注意：测量数据和分选结果只在<测量显示>页有效。
按字体功能键切换字体。

图 4-1 <测量显示> 页

AT4108 显示：



AT4116 显示：



4.1.1 测量【型号】

仪器支持 8 种热电偶型号：T,K,J。

■设置传感器型号的步骤

第 1 步	按【Meas】快捷键进入<测量显示>主页面	
第 2 步	使用光标键选择【TC-T】字段；	
第 3 步	使用功能键选择	
	功能键	功能
	TC-T	设置热电偶型号为 T 型
	TC-K	设置热电偶型号为 K 型
	TC-J	设置热电偶型号为 J 型

4.1.2 通道【001】

■关闭或打开通道的步骤

第 1 步	按【Meas】快捷键进入<测量显示>主页面	
第 2 步	使用光标键选择【001】字段；	
第 3 步	使用功能键选择	
	功能键	功能
	关闭	关闭当前的通道
	打开	打开当前的通道

*关闭或打开其它通道的步骤同上。

■修改显示通道号的步骤


第 1 步	按【Meas】快捷键进入<测量显示>主页面
第 2 步	使用光标键选择【001】字段；
第 3 步	使用数字键盘输入想在当前位置显示的通道号，按【Enter】键结束

*关闭或打开其它通道的步骤同上

表 4-1 图标功能

图示	功能
	当前有 U 盘插入。
	当前的温度单位。
	比较器打开。

5.[Setup]设置显示



- 本章您将了解到所有的设置功能：
- <设置显示>页
 - 温度校正
 - 温度复位

5.1 <设置显示>页

在任何时候，您只要按【Setup】快捷键，就可以进入<设置显示>页。
<设置显示>页可以完成所有与测量有关的设置，但仪器不显示测量结果和分选结果，并且仪器处于等待状态。这些设置包括以下参数：

- 比较 – 比较器功能设置
- 速度 – 采集速度设置
- 讯响 – 蜂鸣器设置
- 单位 – 温度单位设置

图 5-1 <设置显示>页



5.1.1 设置【比较器】

比较器设置包括：打开和关闭。

■设置比较器步骤

第 1 步	按【Setup】快捷键进入<设置显示>主页面	
第 2 步	使用光标键选择【比较】字段；	
第 3 步	使用功能键选择	
	功能键	功能
	关闭	关闭比较器功能且图标 COMP 消失
	打开	打开比较器功能且图标 COMP 显示

5.1.2 设置【速度】

速度设置包括：慢速，中速，快速

■设置速度步骤

第 1 步	按【Setup】快捷键进入<设置显示>主页面	
第 2 步	使用光标键选择【速度】字段；	
第 3 步	使用功能键选择	
	功能键	功能
	慢速	设置采集速度为慢速
	中速	设置采集速度为中速
	快速	设置采集速度为快速

5.1.3 设置【讯响】

讯响设置包括：打开和关闭

■设置讯响步骤

第 1 步	按【Setup】快捷键进入<设置显示>主页面	
第 2 步	使用光标键选择【讯响】字段；	
第 3 步	使用功能键选择	
	功能键	功能
	关闭	关闭报警蜂鸣器
	打开	打开报警蜂鸣器

5.1.4 设置【单位】

单位设置包括：℃，K，°F。

■设置单位步骤

第 1 步	按【Setup】快捷键进入<设置显示>主页面	
第 2 步	使用光标键选择【单位】字段	
第 3 步	使用功能键选择	
	功能键	功能
	℃	温度单位为摄氏度
	K	温度单位为开尔文度
	°F	温度单位为华氏度

5.2 分选设置

按【Setup】键，再按功能键【分选设置】，进入<分选设置>页。

用户可在此页面下完成对各信道数据的上限，下限设置。

图 5-2 分选设置页

<分选设置>		℃	⏏	功能设置
通道	下限	上限	单位	
01	-200.0	1800.0	℃	
02	-200.0	1800.0	℃	
03	-200.0	1800.0	℃	
04	-200.0	1800.0	℃	
05	-200.0	1800.0	℃	
06	-200.0	1800.0	℃	
07	-200.0	1800.0	℃	上一页
08	-200.0	1800.0	℃	下一页
页码: 01 / 02				
键盘被锁定				
文件	系统	⏏开锁	10:41	

5.2.1 【001】

■设置 001 通道下限的步骤：

第 1 步	按【Setup】进入<功能设置>主页面
第 2 步	按【分选设置】键进入<分选设置>页面
第 3 步	使用光标键选择【-200.0】字段
第 4 步	使用数字键盘输入设定的下限值，然后按【Ente】设置结束

■设置 001 通道上限的步骤：

第 1 步	按【Setup】进入<功能设置>主页面
第 2 步	按【分选设置】键进入<分选设置>页面
第 3 步	使用光标键选择【1800.0】字段
第 4 步	使用数字键盘输入设定的上限值，然后按【Ente】设置结束

*设置其它通道上限，下限的步骤同上。

■切换通道页面的步骤：

第 1 步	按【Setup】进入<功能设置>主页面
第 2 步	按【分选设置】键进入<分选设置>页面
第 3 步	按功能键【上一页】或【下一页】切换页面

5.3 U 盘设置

按【Setup】键，再按功能键【U 盘设置】，进入<U 盘设置>页。

用户可在此页面下完成对 U 盘文件的设置。

图 5-4 U 盘设置页



5.3.1 【创建文件】

■创建新檔的步骤：

第 1 步	按【Setup】键进入【功能设置】页	
第 2 步	按功能键【U 盘设置】键进入<U 盘设置>页面	
第 3 步	使用光标键选择【文件】字段	
第 4 步	使用功能键选择	
	功能键	功能
	创建文件	创建新的文件，使用数字键盘输入文件名，按【Enter】键结束，檔格式为 *.csv。

5.3.2 【记录时间】

■设置记录时间的步骤：

第1步	按【Setup】进入<功能设置>主页面；
第2步	按功能键【U 盘设置】键进入<U 盘设置>页面
第3步	使用光标键选择【间隔】字段
第4步	使用功能键选择
第5步	使用数字键盘输入时间值（最快 5 秒，最慢 3600 秒），然后按【Ente】设置结束

5.3.3 【01】

■文件设置的步骤：

第1步	按【Setup】进入<功能设置>主页面；	
第2步	按功能键【U 盘设置】键进入<U 盘设置>页面	
第3步	使用光标键选择【01】字段	
第4步	使用功能键选择	
第4步	功能键	功能
	打开	打开当前选择的文件，把数据记录在此文件里
	关闭	关闭当前选择的文件
	删除	删除当前选择的文件

注意：

USB 记录数据只在【MEAS】测量界面或【曲线图】界面才起效。数据记录时间以仪器内部时钟为准，当仪器内部时钟停止工作时，数据记录就会停止工作。内部时钟不工作的时候需要更换内部的电池。
数据包括两个部分，记录时间和对应通道温度。


例：

文件名：153035.CSV

数据格式为 float 型，保留小数点后一位，通道以 “,” 号分割。

MODEL-TC-T (°C)	CH01	CH02	CH03	CH04	CH05	CH06	CH07	CH08
2013-12-04 15:00:00	28.0	28.1	100.5	19.2	32.4	54.3	21.6	41.9
2013-12-04 15:00:05	28.1	28.0	100.4	19.2	32.4	54.2	21.5	42.0
2013-12-04 15:00:10	28.0	28.1	100.5	19.1	32.3	54.2	21.5	42.0
2013-12-04 15:00:15	28.0	28.1	100.5	19.2	32.4	54.2	21.5	42.0

6.系统配置



- 本章您将了解到仪器的系统配置：
- 系统配置页
 - 系统信息页
 - 系统服务页

6.1 <系统配置>页

在任何时候，您只要按【Meas】或【Setup】快捷键，选择任务栏【系统】键，进入<系统配置>页。
<系统配置>页包括以下设置：

- 语言
- 日期/时间设置
- 账号/密码设置
- 波特率设置

图 6-1 系统配置页



6.1.1 系统【语言】

仪器支持中文和英文两种语言。
■设置语言步骤：

第1步	按【Meas】或【Setup】快捷键，进入主页面	
第2步	在任务栏选择【系统】键，进入<系统配置>页面	
第3步	使用光标键选择【语言】字段	
第4步	使用侧边栏功能键设置语言	
	功能键	功能
	CHINESE	中文
	ENGLISH	英语

6.1.2 系统【日期】、【时间】

仪器使用 24 小时制时间。
■设置日期步骤：

第1步	按【Meas】或【Setup】快捷键，进入主页面
-----	--------------------------

第 2 步	在任务栏选择【系统】键，进入<系统配置>页面	
第 3 步	使用光标键选择【日期】字段	
第 4 步	使用侧边栏功能键设置日期	
	功能键	功能
	年+	+1 年
	年-	-1 年
	月+	+1 月
	月-	-1 月
	日+	+1 日
	日-	-1 日

■设置时间步骤：

第 1 步	按【Meas】或【Setup】快捷键，进入主页面	
第 2 步	在任务栏选择【系统】键，进入<系统配置>页面	
第 3 步	使用光标键选择【时间】字段	
第 4 步	使用侧边栏功能键设置时间	
	功能键	功能
	时+	+1 小时
	时-	-1 小时
	分+	+1 分钟
	分-	-1 分钟
	秒+	+1 秒
	秒-	-1 秒

注：如果内部电池电量不足，时钟就会停止运行，这时需要更换新的电池。

6.1.3 系统【账号】、【密码】

仪器有两种模式供选择：

- 管理员 – 除了【系统服务】页外，其它功能都对管理员开放。
- 用户 – 除了【系统服务】和【文件】页外，其它功能用户可以操作。

■设置账号步骤：

第 1 步	按【Meas】或【Setup】快捷键，进入主页面	
第 2 步	在任务栏选择【系统】键，进入<系统配置>页面	
第 3 步	使用光标键选择【账号】字段	
第 4 步	使用侧边栏功能键更改账号	
	功能键	功能
	管理员	除了<系统服务>页面外，其它功能都对管理员开放。
	用户	除了【系统服务】页和【文件】页外，其它功能用户可以操作，设置的资料不保存。

■设置管理员密码步骤：

第 1 步	按【Meas】或【Setup】快捷键，进入主页面	
第 2 步	在任务栏选择【系统】键，进入<系统配置>页面	
第 3 步	使用光标键选择【密码】字段	
第 4 步	使用侧边栏功能键设置密码	
	功能键	功能
	更改密码	输入最多 9 位的数字密码，密码只包括数字和符号。如果忘记密码，请致电我公司销售部。

	删除密码	管理员将不受密码保护
--	------	------------

6.1.4 系统【波特率】

仪器波特率设置：

■设置波特率步骤：

第1步	按【Meas】或【Setup】快捷键，进入主页面	
第2步	在任务栏选择【系统】键，进入<系统配置>页面	
第3步	使用光标键选择【波特率】字段	
第4步	使用侧边栏功能键更改账号	
	功能键	功能
	9600	设置通讯波特率为 9600
	19200	
	38400	
	57600	
	115200	

6.2 <系统信息>页

<系统信息>页没有用户可配置的选项。

图 6-2 系统信息页



■查看系统信息步骤：


第1步	按【Meas】或【Setup】快捷键，进入主页面
第2步	在任务栏选择【系统】键，进入<系统配置>页面
第3步	选择侧边栏【系统信息】功能键，进入<系统信息>页面

6.3 <系统服务>页



警告：此页面不对用户开放，出厂时用来校准数据。非专业人士，不可强行进入。否则校准数据可能会丢失，导致测量数据偏差很大。

7.文件配置



本章您将了解到仪器的文件配置：

- 文件管理页


7.1 <文件管理> 页

在任何时候，您只要按【Meas】或【Setup】快捷键，选择任务栏【文件】键，进入<文件管理>页。

<文件管理>页包括以下设置：

- 文件


图 7-1 文件管理页

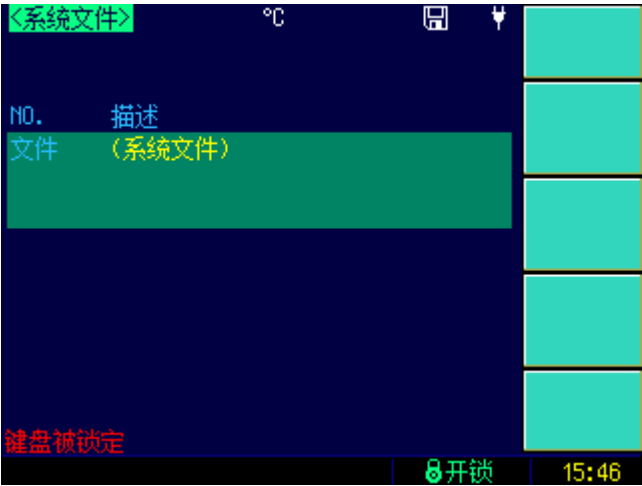

■设置语言步骤：

第1步	按【Meas】或【Setup】快捷键，进入主页面	
第2步	使用光标键选择【系统文件】字段	
第3步	使用侧边栏功能键设置文件	
	功能键	功能
	保存	保存当前的仪器设置
	读取	读取保存的仪器设置
	删除	删除保存的仪器设置

8.远程控制



本章提供以下信息通过 RS-232C 或 USB 转接盒来远程控制 AT4108/4116

- 关于 RS-232C
- 关于 USB 转接盒
- 选择波特率.
- 关于 SCPI

8.1 关于 RS-232C

您可以连接到一个控制器（如 PC 和 PLC）的 RS-232 接口使用 Applent RS- 232 DB-9 串口通讯线，串口使用发送（TXD），接收（RXD）和信号地（GND）线的 RS-232 标准。未使用硬件握手 CTS 和 RTS 线。



注意：
仅能使用 Applent 的（非调制解调器）DB -9 电缆。
电缆长度不应超过 2 米。

图 8 1 一起上的 RS-232 连接器

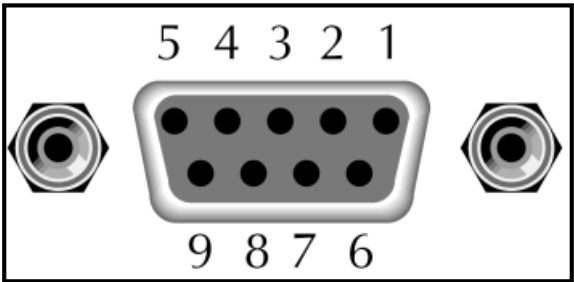


表 8-1 RS-232 连接器引脚

NAME	DB-25	DB-9	NOTE
DCD	8	1	NC
RXD	3	2	数据发送端
TXD	2	3	数据接收端
DTR	20	4	NC
GND	7	5	地线
DSR	6	6	NC
RTS	4	7	NC
CTS	5	8	NC

- 确保控制器连接到 AT4108/4116 并使用这些设置。
RS-232 接口传输数据使用：
8 数据位，
1 停止位，
没有奇偶校验位.

8.2 关于 USB 转接器(可选)

USB 转接器可让 AT4108/4116 连接到您 PC 上的 USB 端口。



注意：
请安装 USB-串口驱动程序，然后使用 USB 串行接口。
Applent 的 USB 转接器是 ATN2 。

图 8-1 USB 转接器 ATN2



8.3 选择波特率

在你能够通过内置的 RS-232 控制器发送 RS-232 命令控制仪器 AT4108/4116 前，你必须配置 RS-232 的波特率。

AT4108/4116 的 RS-232 接口使用 SCPI 语言

RS-232 的配置

RS-232 的配置如下：

数据位： 8-bit

停止位： 1-bit

校验位： 无

设置波特率

Step 1. 请按[Setup] 键

Step 2. 使用光标键选择【BAUD】

Step 3. 使用功能键选择波特率

功能键	功能
9600	
19200	
38400	
57600	
115200	推荐


8.4 SCPI 语言

完全支持可编程仪器的标准命令（SCPI）



注意：
AT4108/4116 仅支持 SCPI 语言。

9. SCPI 命令参考



本章包含编程 AT4108/4116 的 SCPI 命令的参考信息。

- 命令解析器——了解命令解析器的一些规则。
- 命令和参数——命令行的书写规则
- 命令参考

本章节提供了仪器使用的所有的 SCPI 命令，通过这些 SCPI 命令，可以完全控制仪器所有功能。

9.1 命令串解析

主机可以发送一串命令给仪器，仪器命令解析器在捕捉到结束符（\n）或输入缓冲区溢出后开始解析。

例如：

合法的命令串：

AAA:BBB CCC;DDD EEE::FFF

仪器命令解析器负责所有命令解析和执行，在编写程序前您必须首先对其解析规则有所了解。

9.1.1 命令解析规则

1. 命令解析器只对 ASCII 码数据进行解析和响应。
2. **SCPI 命令串必须以 NL（'\n' ASCII 0x0A）为结束符**，命令解析器在收到结束符后或缓冲区溢出才开始执行命令串。
3. 如果指令握手打开，命令解析器在每接受到一个字符后，立即将该字符回送给主机，主机只有接收到这个回送字符后才能继续发送下一个字符。
4. 命令解析器在解析到错误后，立即终止解析，当前指令作废。
5. 命令解析器在解析到查询命令后，终止本次命令串解析，其后字符串被忽略。
6. 命令解析器对命令串的解析不区分大小写。
7. 命令解析器支持命令缩写形式，缩写规格参见之后章节。

9.1.2 符号约定和定义

本章使用了一些符号，这些符号并不是命令树的一部分，只是为了能更好的对命令串的理解。

<> 尖括号中的文字表示该命令的参数

[] 方括号中的文字表示可选命令

{ } 当大括号包含几个参数项目时，表示只能从中选择一个项目。


() 参数的缩写形式放在小括号中。

大写字母 命令的缩写形式。

9.1.3 命令树结构

对 SCPI 命令采用树状结构的，可向下三级（注：此仪器的命令解析器可向下解析任意层），在这里最高级称为子系统命令。只有选择了子系统命令，该其下级命令才有效，SCPI 使用冒号（:）来分隔高级命令和低级命令。

图 9-1 命令树结构

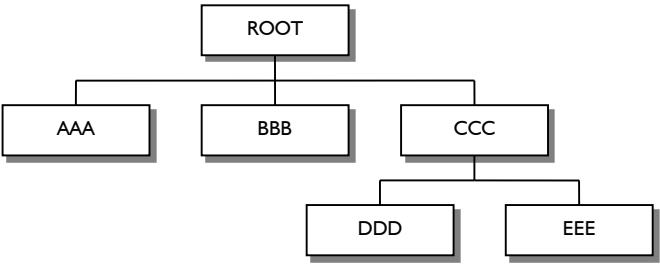

举例说明

ROOT:CCC:DDD PPP
ROOT 子系统命令
CCC 第二级
DDD 第三级
PPP 参数

命令和参数

一条命令树由 **命令和[参数]** 组成，中间用 1 个空格 (ASCII: 20H) 分隔。

举例说明

AAA:BBB 1.234
命令 [参数]

9.1.4 命令

命令字可以是长命令格式或缩写形式，使用长格式便于工程师更好理解命令串的含义；缩写形式适合书写。

9.1.5 参数

- 单命令字命令，无参数。
例如：AAA:BBB
- 参数可以是字符串形式，其缩写规则仍遵循上节的“命令缩写规则”。
例如：AAA:BBB CCC
- 参数可以是数值形式
 - `<integer>` 整数 123 , +123 , -123
 - `<float>` 浮点数
 1. `<fixfloat>` : 定点浮点数 : 1.23 , -1.23
 2. `<Sciloat>` : 科学计数法浮点数 : 1.23E+4 , +1.23e-4
 3. `<mpfloat>`: 倍率表示的浮点数 : 1.23k, 1.23M, 1.23G, 1.23u

表 9-1

倍率缩写

数值	倍率
1E18 (EXA)	EX
1E15 (PETA)	PE
1E12 (TERA)	T
1E9 (GIGA)	G
1E6 (MEGA)	MA
1E3 (KILO)	K
1E-3 (MILLI)	M
1E-6 (MICRO)	U
1E-9 (NANO)	N
1E-12 (PICO)	P
1E-15 (PEMTO)	F
1E-18 (ATTO)	A



提示：倍率不区分大小写，其写法与标准名称不同。

9.1.6 分隔符

仪器命令解析器只接受允许的分隔符，除此之外的分隔符命令解析器将产生 “Invalid separator(非法分割符)” 错误。这些分隔符包括：

- ； 分号，用于分隔两条命令。
例如：AAA:BBB 100.0;CCC:DDD
- ： 冒号，用于分隔命令树，或命令树重新启动。
例如：AAA:BBB:CCC 123.4:DDD:EEE 567.8
- ? 问号，用于查询。
例如：AAA?
- 空格，用于分隔参数。
例如：AAA:BBB □ 1.234

主机可以发送一串命令给仪器，仪器命令解析器在捕捉到结束符（\n）或输入缓冲区溢出后开始解析。

例如： 合法的命令串：

AAA:BBB CCC;DDD EEE;FFF

仪器命令解析器负责所有命令解析和执行，在编写程序前您必须首先对其解析规则有所了解。

9.2 命令参考

所有命令都是按子系统命令顺序进行解释，下面列出了所有子系统

- MEAS 测量设置子系统
- SYST 系统设置子系统
- FETCH 获取数据子系统
- ERROR 错误子系统
- IDN? 查询子系统

9.2.1 MEAS 子系统

MEAS 子系统用来设置测量页面

Figure 9-1MEAS 命令树

Meas	:MODEL	{tc-t,tc-k,tc-j}
	:RATE	{fast,med,slow}
	:KEYLOCK	{on,off}
	:CHAN	<integer>

9.2.1.1 MEAS:MODEL

MEAS:MODEL 用来设置传感器型号

Command Syntax	MEAS:MODEL <tc-t,tc-k,tc-j>
Example	SEND> MEAS:MODEL TC-T<NL> //设置传感器型号为 T 型热电偶
Query Syntax	MEAS:MODEL?
Query Response	< tc-t,tc-k,tc-j ><NL>
Example	SEND> MEAS:MODEL?<NL> RET> tc-t<NL>

9.2.1.2 MEAS:RATE

MEAS:RATE 用来设置采样速度

Command Syntax	MEAS:RATE <fast,med,slow>
Example	SEND> MEAS:RATE fast<NL> //设置采样速度为快速
Query Syntax	MEAS:RATE?
Query Response	<fast,med,slow><NL>
Example	SEND> MEAS:RATE?<NL> RET> fast<NL>

9.2.1.3 MEAS:KEYLOCK

MEAS:KEYLOCK 用来设置键盘锁

Command Syntax	MEAS:KEYLOCK <on,off>
Example	SEND> MEAS:KEYLOCK off<NL> //设置键盘锁关闭
Query Syntax	MEAS:KEYLOCK?
Query Response	<on,off><NL>
Example	SEND> MEAS:KEYLOCK?<NL> RET> on<NL>

9.2.1.4 MEAS:CHAN

MAEAS:CHAN 用来设置通道状态.

Command Syntax	MEAS:CHAN <integer>
Parameter	<整数> 从十进制转换为二进制,例如: 1,8 通道完全打开的地址位,二进制 11111111 低位为通道 CH01,每个 BIT 位对应 1 个通道,BIT 位是 1 则打开通道,0 则关闭通道
Example	SEND> MEAS:chan 256<NL> //设置通道 9 打开
Query Syntax	MEAS:CHAN?
Query Response	<integer,integer><NL>
Example	SEND> MEAS:CHAN?<NL> RET> 254<NL>

9.2.2 SYST 子系统

SYST 子系统用来设置 SETUP 页面

Figure 9-3SYST 命令树

Meas	:COMP	{on,off}
	:BEEP	{on,off}
	:UNIT	{cel, kel, fah}

9.2.2.1 SYST:COMP

SYST:COMP 用来设置比较器状态

Command Syntax	MEAS:COMP <on,off>
Example	SEND> SYST:comp on<NL> //设置比较器开
Query Syntax	MEAS:comp?
Query Response	<on,off><NL>
Example	SEND> SYST:comp?<NL> RET> on<NL>

9.2.2.2 SYST:BEEP

SYST:BEEP 用来设置讯响状态

Command Syntax	MEAS:BEEP <on,off>
Example	SEND> SYST:beep on <NL> //设置蜂鸣器打开
Query Syntax	MEAS:beep?
Query Response	<on,off><NL>
Example	SEND> SYST:beep?<NL> RET> on<NL>

9.2.2.3 SYST:UNIT

SYST:UNIT 用来设置温度单位

Command Syntax	MEAS:UNIT <cel,kel,fah>
Parameter	<cel,kel,fah> cel: 摄氏度 kel: 开尔文度 fah: 华氏度
Example	SEND> SYST:unit cel<NL> //设置温度单位为摄氏度
Query Syntax	MEAS:unit?
Query Response	<℃,K,F><NL>
Example	SEND> SYST:unit?<NL> RET> ℃<NL>

9.2.3 FETCH 子系统

FETCH 子系统用来获取温度数据

Figure 9-4FETCH 命令树

fetch?	
--------	--

9.2.3.1 FETCH?

FETCH? 用来获取温度数据

Query Syntax	Fetch?
Query Response	<float,float,float><NL>
Example	SEND> fetch?<NL> RET> +1.00000e-05, +1.00000e-05, +1.00000e-05<NL>

9.2.4 ERROR 子系统


ERROR 子系统返回错误信息

Query Syntax	ERROR?
Query Response	Error string
Example	SEND> ERR?<NL> RET> no error<NL>

9.2.5 IDN 子系统

IDN?用来查询仪器 ID 号

Query Syntax	IDN? Or *IDN?
Query Response	<MODEL>,<Revision>,<SN>,<Manufacturer>



- 本章您将了解到以下内容：
- 基本技术指标
 - 规格
 - 外形尺寸

11.1 技术指标

下列资料在以下条件下测得：

- 温度条件：23℃±5℃
- 湿度条件：≤65% R.H.
- 预热时间：>60 分钟
- 校准时间：12 个月

测量环境：

- 指标：温度 15℃~35℃ 湿度<80%RH
- 操作：温度 10℃~40℃ 湿度 10~90%RH
- 存储：温度 0℃~50℃ 湿度 10~90%RH

- 热电偶型号： T,K,J
- 基本准确度： 0.2%+1 个字
- 显示位数： 主参数 5 位
- 测试速度： 快速，中速，慢速
- 最大读数： 1800.0
- 最小读数： -200.0
- 数据记录： USB 存储器。
- 讯响： 开/关。
- 界面： RS232 界面；
- 编程语言： SCPI
- 辅助功能： 键盘锁


型号	测试温度范围（℃）
T 型热电偶	-150℃ ~ 400℃
K 型热电偶	-100℃ ~ 1350℃
J 型热电偶	-100℃ ~ 1200℃

11.2 规格

- 3.5 英寸，真彩 16M 色，TFT-LCD 显示。
- 比较器（分选）功能：内建分选记录
- 键盘锁定功能
- 中、英文切换
- 内置 RS232 通讯接口
- 兼容 SCPI 指令集
- 重量：5000g

11.3 外形尺寸

(示意图)

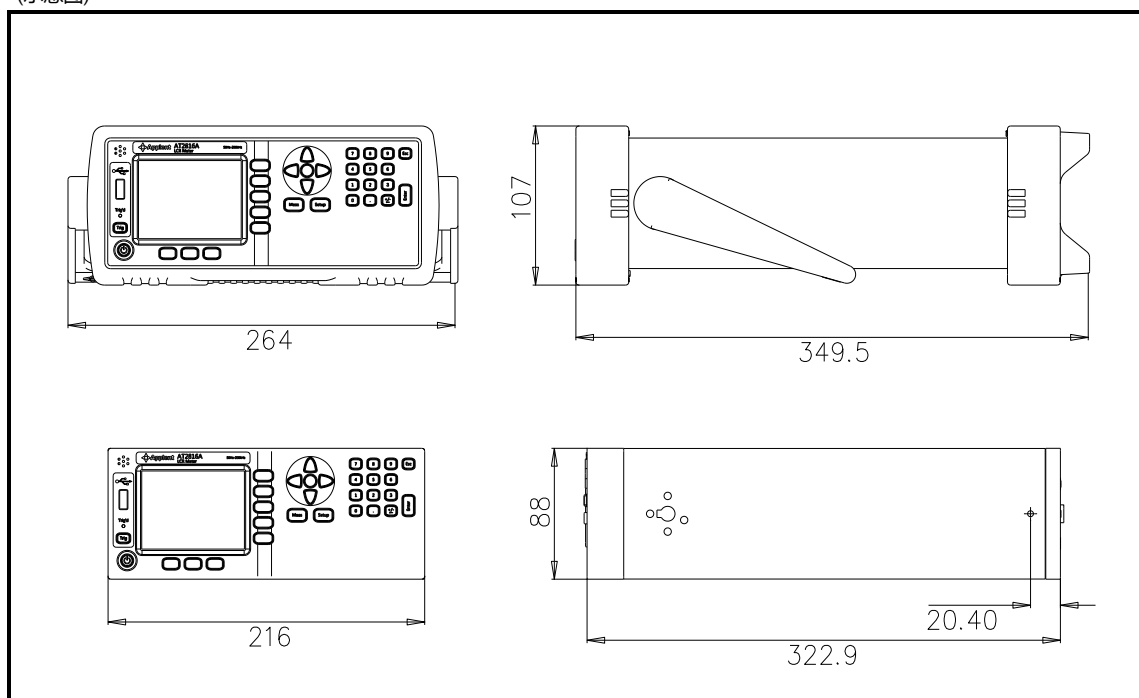

Applent Instruments

-AT4108/4116 用户手册-

简体中文版

©2005-2016 版权所有：常州安柏精密仪器有限公司

Applent Instruments Inc.