

8601酸碱计中文说明书



CE

型号: ■ 8601

功能描述

此款AZ衡欣8601工业便携pH计酸碱计仪,可同时显示pH值以及温度三种数值,测棒具备自动温度补偿功能,测量精准。AZ衡欣8601酸碱pH检测仪附酸碱度校正液组,可做三点校正。手持式设计,方便携带,不受任何地点场所的限制便可即时量测。

在开机3秒后,pH计的LCD荧幕就会显示所有的内容。虽然您可能在荧幕上看到了DATALOGGER,Y/M/D,mg/l,mS,ppm.,但是8601这个型号并没有这些功能。具有datalogger功能的型式为8601D机种,请联络商店或您购买酸碱计的经销商。

LCD的荧幕被分为3个部份:一个大的在顶端的荧幕(主要的),两个较小的在下端的荧幕(右下角为时钟)。这三个荧幕显示可让您不断的更新pH的测量,并且当您校正时可更新相对的mV值及温度值。

显示

§ 主荧幕会显示测量出来的pH或mV的数值。


§ 次荧幕会显示温度的数值。

§ pH或者mV的单位会显示在荧幕的右上方,除非感应器有插入pH计中,否则所测出的数值会在荧幕上不断改变。这些数值是不能参考的。


§ °C或°F和ATC的单位会显示荧幕的左下方。

§ 如果没有温度感应器就不会显现“ATC”。

控制及显示记号

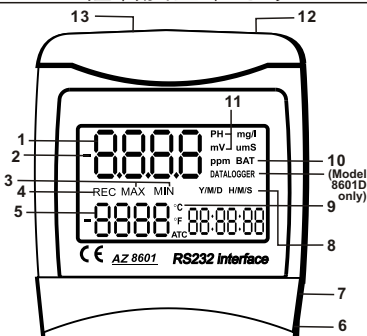


1. 主要的荧幕显示pH或mV的数值，校正的值。
2. 一负值的显示记号。
3. MAX/MIN最大及最小的pH/mV记录。
4. REC：开始记录模式，会记录最大及最小的pH记录值。
5. 次荧幕显示温度值。
6. DC电流插入孔。
7. RS232输出孔。
8. H/M/S 88:88:88的资料显示以小时/分/秒来显示。
9. °C及°F的显示从°C转换到°F或者从°F转换到°C。
10. BAT电池电力不足的指示。
11. PH/mV的显示可从pH转换成mV或者从mV转换成pH。
12. 温度感应器的插入孔。
13. BNC接头及测棒插入位置。



pH探头

当仪器处于存储状态时,保持pH探头湿润很重要。

探头由装满探头保护液的塑料瓶保护,但您需要使用或保存探头时,请依据以下步骤进行操作。

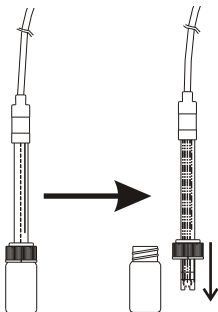

步骤1

旋转保湿瓶并将其取下,放置在一边,以免打翻。

步骤2


将瓶盖从测棒上取下。

使用后,请重新套上瓶盖,并将探头插入瓶中旋转保湿瓶并拧紧,保持密封。

自动关机(睡眠功能)


每次开机后20分钟,pH计就会自动关机。如果想要长时间记录或操作,可在开机前,同时按 **①** 及 **CAL** 键,此时一个“n”会出现在荧幕的正中央,您可放开 **CAL** 这个键(图Fig.A) 就可解除睡眠装置。

在关机后,这个解除睡眠装置的模式就无效了。



选择模式

使用系统的启动模式可删除或更换不同的启动模式。荧幕会维持上一次所使用的模式。为了方便,pH计会维持上次操作时所设定的模式。按指示的按键,就可使用下列的操作模式。




① 启动pH计(图Fig.B)及关闭。

REC 按一下此键,相对时钟就会在右下方启动。REC会显示在左方中间的位置(图Fig.C),除了电源、°C/°F及背光的功能外,其它的功能都锁住。


再按一下,测量单位的显示会从MAX(看Fig.D)到MIN(图Fig.E)并且再回到现在的pH值进行循环;记录的模式会显示在LCD荧幕上。按着REC键3秒不放,可关掉记录模式并且回到正常模式。

CAL 按CAL键可进入校正模式(图Fig F)。

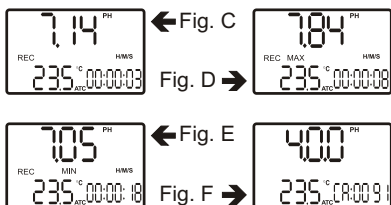

pH/mV 按pH/mV键可转换荧幕显示单位,从pH换成mV或者从mV换成pH。(图Fig.G)

C/F 按°C/°F键可转换温度的单位(°C和°F) (图Fig.H);单位的模式会显示在中下方,或者在校正模式下按一下可跳过目前的档而进行到下一步。按一下  键,背光会产生约30秒,然后就自动关掉。或者当正在进行校正模式时,按此键选择校正标准值。



自动温度补偿(ATC)

这个pH计是使用 **AZ86P3** 3合1的测试棒,此为内置温度感应器用来做自动温度补偿。这个pH计可以用自动或手动方式的温度补偿来做测量。


确定您使用的**AZ86P3**测试棒是插入pH计中来**做ATC**,否则您也可使用**AZ86P2**(2合1测试棒)和另外的一个温度测试棒,这个测试棒必须完全的放入您所要测试的液体中,建议使用**AZ**本厂制造的。

如果没有连接任何温度感应器到这个pH计,系统会自动设定现在的温度为**25°C**,使用另一个独立的温度计来设计符合工作状况的温度,并且记录工作中液体的温度去改变本表的温度值。

校正程序

本仪器校准是必要的，应该定期进行。

1. 开机。依次进行pH4、pH7、pH10的校正。
2. 按 **(CAL)** 键去进入pH的校正模式,您将会看到“4.00 pH”在LCD的荧幕上。如果没有正确的放入缓冲液,或者测试棒有损毁,“Err”会出现在右下方(图Fig.1)。



3. 按  去增加数值(图Fig.J)或按  去减少数值(图Fig.K),这个数值就是您所使用的溶剂的校正值。以4.00pH为准的校正点可更改的范围为3.50到4.50(图Fig.J,K)。



4. 确定测量的pH值,是固定在右下角的,意思就是pH计已根据所使用的缓冲液去设定完成4.0pH的校正点。(附注:在CAL旁所显示的数值就是相对的mV读值,mV的参考值为4位数,应加小数点在第三个数字后才是正确的mV数值。


5. 按  键去储存校正的值,“SA”到出现在LCD的荧幕上(图Fig.L)。



如果要校正多点的数值,按  键就可进入下一个pH7.0的校正程序。

6. 将试棒用去离子水或者清洁剂去清洗,按照设定 pH4.0 的程序去设定 pH7.0 的校正值,7.0 pH校正点的更改范围可从 6.50 到7.50。

当校正完成时,按 **REC** 去储存校正,否则可以按 **C/F** 跳到另一个校正值(pH10) (图Fig.M)。



7. 按照校正 pH4.0 及 pH7.0 的相同方式去校正pH10,校正值的可更改范围是从 9.50 到 10.50 (图Fig. N)。

8. 储存完成 pH10.0 的校正值后,您将会看到一个“END”出现在荧幕上,也就是校正已完成(图Fig.O)。

9. 如遇到问题请及时联系客服。



附注：

仪表可手动设置温度值,以确保准确的pH测量。当您的pH电极是ATC专用功能时,使用此功能。请遵循以下步骤。

A) 按下 **CAL** 按钮启动pH4.00校准点,为设置温度值,按住按钮 **C/F** 2秒,将显示“St”高于默认25°C。(见图I-1) 按下按钮 **pH/mV** 增加温度值,或按下 **⚡** 按钮降低温度值。

温度范围为 $-5^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$,按下 **REC** 按钮保存温度值。

B)使用二合一电极 (86P2AZ) 或任何兼容的pH电极 (无温度补偿) 轻松测量pH值，现在您将看到温度设置值取代预设温度。

Fig I-1



保 养

- ✓ 盖着橡皮的盖子是为保持pH的玻璃球在潮湿的状况，如此能保护及储存电极体。您也可以存放在pH4.0的缓冲液中，这个缓冲液含有浓度0.01的氯化钾。
- ✓ 在每次使用前都用去离子水来清洗pH电极体。
- ✓ 不要碰触或磨擦玻璃球才能延长pH电极体的寿命。

疑问解答

- ？ 有电源但是没有显示
检查电池是不是在,确定电池有装好,正负极是正确的,可换一个新的电池。如果是因为电力不足的电池所造成,则可以连接DC变压器。

? 无法读值.

清洗测试棒且重新校正,并且所测量的液体要完全覆盖测试盖的感应器,或者换一个新的测试棒并且重新校正是否测试棒有破损。

? 缓慢的回应

将测试棒的电极体放在水龙头下用水清洗10~15分钟,然后用蒸馏水完全浸泡,或者使用一般的电极体清洁剂。

? CAL: Err.

校正错误。换正确的缓冲液,或者缓冲液的pH不正确,也可能是测试棒有毁损,可换一个新的,并且重新校正。

? 电池指示


换新的电池(图Fig.P)。

? E.1.

超过pH的范围,太酸 (<1pH) (图Fig.Q)。

? E.2.

超过pH的范围,太碱 (>14pH),接上pH电极体及温度测试棒(图Fig.R)。

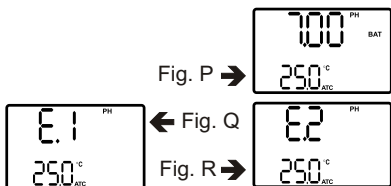

更换电池

下列状况时需更换新的9-volt电池:

- ✓ **BAT**的字样出现在荧幕的右方。
- ✓ 无法启动pH计。
- ✓ 使用背光时,会有**BAT**的字样出现。

注意: 如果pH计无法启动时,检查一下电压值是否正确,即使电池是刚换不久的。

换电池的步骤:

1. 先拿掉pH计的测试棒。
2. 将pH计的背面朝上放在一个干净平坦的面板上。
3. 用螺丝起子打开电池盖,拿下旧的电池,注意电池的正负极,放入新的电池后,盖上盖子。



注意:

如果超过一个月不使用这个pH计,要将电池取下,不要将电池一直留在pH计里面。

操作状况

- ✓ 输入阻抗： 10^{12} ohms
- ✓ 操作温度 $0^{\circ}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ($32\sim 122^{\circ}\text{F}$)
- ✓ 操作最大湿度 80% RH
- ✓ 建议的校正缓冲液：
 - USA缓冲液 (pH 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45)
 - NIST缓冲液 (pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45)
 - DIN缓冲液 (pH 1.09, 3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75)
- ✓ 电源：一个 9.0 volt 的电池。

规格表

	pH	mV
测量范围	0.00 ~ 14.00	-499 ~ +499
分辨率	0.01pH	0.1mV (±0.1~195) 1 mV (±190~499)
准确度	±0.02pH	±0.2 mV ±2 mV
尺寸	72 x 182 x 30 mm (meter)	
重量	大约 220 gram (包括电池)	
温度补偿从 -5 ~ 80°C , 准确度： ± 0.3°C		
格式	速率： 2400 秒/位元 资料位元： 8 , 停止位元： 1	
: P xx.xx : t xxx.xc ; P xx.xx : t xxx.xF : or m xxx.x mV : t xxx.xc ; m xxx.x mV : t xxx.xF or m xxxx mV : t xxx.xc ; m xxxx mV : t xxx.xF : or m _____ : t _____ (w/o probe) p _____ : t _____ (w/o probe)		

配备

整个pH计包含：

- ✓ pH计本身
- ✓ 电池(9.0volt)
- ✓ 操作手册
- ✓ 手提盒

可选择的配件

- ✓ AZ86P3：ATC三合一pH电极体，附(102cm)电线及橡胶盖子
- ✓ AZ86P2：没有ATC的二合一pH电极体。
- ✓ Rs232软件磁碟片及附cable。
- ✓ 标准缓冲液。
- ✓ Dc电压转换器。

RS232输出

PH计可以连接个人计算机去下载在线的资料,显示pH/mV或pH/°C°F的记录,并且做资料的分析、储存资料、统计、显示多重档案、取回档案等。

连接程序：

- 1.将附件RS232的电线插入DC jack 的孔(在pH计的右边)。
- 2.将D-sub 9P type 的接头插入计算机的Com.1或2的孔。
- 3.放入光盘片及磁碟片来启动RS232的软件。
- 4.安装RS232软件时,要遵照说明书上的操作程序。

保 修

自购买日算起,pH计保修期为一年。

产品保证包含在正常使用下的不良状况,但不包含电池、滥用、变更、疏忽、不当的保养或者是因漏电电池而造成的损害。

保证维修时需购买证明。如果将pH计拆开后,保修即失效。

退货授权

无论因为什么原因要退货,必须在退货前,取得供应商的授权。需要RA(退货授权)时,请附上不良原因的相关资料。

退回品必须包装良好,以免在运回的过程中有任何的损毁,以确保任何可能的损失。

本公司提供精准优质测量仪器！

湿度计/干湿球温度计

温度计

风速计

噪音计

风量计

红外线温度计

K 热电耦温度计

K.J.T. 热电耦温度计

K.J.T.R.S.E. 热电耦温度计

酸碱计

电导计

可溶解固体总量计

溶氧计

压力计

转速计

照度计

水分计

记录器

温湿度传输器

无线记录器.....

请上我们的网站浏览更多的产品！

[Https://www.az-instrument.cn/](https://www.az-instrument.cn/)