

使用说明书

OPERATION MANUAL

MODEL YD2882-5/5A 型

脉冲式线圈匝间测试仪

IMPULSE WINDING TESTER

版本号 V4.0

常州市扬子电子有限公司

目 录

第一章 概述	1
1.1 引言	1
1.2 原理说明.....	1
1.2.1. 层间短路测试原理.....	1
1.2.2 仪器原理框图.....	2
1.2.3 仪器工作原理.....	2
1.3 线圈质量检查判断方法	2
1.3.1 波形面积比较 (AREA SIZE)	2
1.3.2 波形差面积比较(DIFFERENTIAL AREA).....	3
1.3.3 波形电晕量比较 (FLUTTER VALUE)	3
1.3.4 波形相位 (过零点)比较(ZERO CROSS).....	3
第二章 面板说明	3
2.1 前面板示意图	3
2.2 前面板说明	3
2.2 后面板示意图	5
2.4 后面板说明	5
2.5 HANDLER 分选接口说明	6
2.5.1 关于 HANDLER 接口引脚功能图.....	6
2.5.2 关于 HANDLER 接口说明.....	6
2.6 RS232C 通讯接口说明.....	6
第三章 注意事项	7
3.1 安全使用注意事项	7
3.1.1 使用注意事项.....	7
3.1.2 仪器开机注意事项.....	7
3.2 声响方式使用注意事项	7
第四章 基本操作说明	8
仪器基本测试方式.....	8
4.1 测试.....	8
4.1.1 普通线圈测试模式.....	8
4.1.2 快速测试模式 (普通线圈、三相电机)	8
4.1.3 外部 RS232 多绕组型测试模式 (*选项)	9
4.1.4 外部 PC 机测试模式 (*选项)	9
4.1.5 内部多绕组测试模式.....	9
4.1.6 脚控(FOOT CONTROL)使用.....	9
4.1.7 快速探查方式.....	10
4.2 参数	10
4.3 编辑	11
4.3.1 标准波形及参数编辑.....	11
4.3.2 极性选择 (音圈)	13
4.3.3 多标准样件的标准采集.....	13
4.4 工具	13
4.5 系统.....	13
第五章 测试操作说明	15

5.1 单绕组(单线圈)测试.....	15
5.1.1 连接被测产品。.....	15
5.1.2 选择测试模式。.....	15
5.1.3 编辑标准参数及波形。.....	15
5.1.4 管理标准参数及波形。.....	15
5.1.5 测试。.....	15
5.2 三相电机绕组测试.....	16
5.2.1 连接被测产品。.....	16
5.2.2 选择测试模式。.....	16
5.2.3 编辑标准参数及波形。.....	16
5.2.4 管理标准参数及波形。.....	16
5.2.5 测试。.....	16
5.3 单相电机绕组测试.....	17
5.3.1 连接被测产品。.....	17
5.3.2 选择测试模式。.....	17
5.3.3 编辑标准参数及波形。.....	17
5.3.4 管理标准参数及波形。.....	17
5.3.5 测试。.....	17
第六章 成套与保修.....	18
6.1 成套.....	18
6.2 保修.....	18
附件.....	19
附件 1: 脉冲式线圈匝间测试仪 通讯协议 V4.0.2.....	19
1 串口通讯格式: (收发格式相同 HEX).....	19
1.1 通讯协议格式 (n=1~250).....	20
1.2 读取命令码格式.....	21
1.3 写入命令码格式.....	22
2.0 PC 机读取指令.....	23
2.1 PC 机发送(读取)指令串.....	23
2.2 接收代码示例.....	24
3.0 PC 机写入指令.....	26
3.1 PC 机发送(写入)指令串.....	26
3.2 接收代码示例.....	27
4.0 参数区内容详解.....	28
4.1 系统参数.....	28
4.2 测试波形.....	28
4.3 测试参数.....	29
5.0 错误信息详解.....	30
5.1 读取错误信息.....	30
5.2 写入错误信息.....	31

第一章 概述

1.1 引言

脉冲式线圈匝间测试仪（即数字式匝间仪）可高效的、非破坏性的对有线圈绕组的部件进行电气试验。其原理是对标准线圈绕组和被测试绕组施加相同的脉冲电压，比较两者的瞬态波形，以测试被测线圈的品质。瞬态波形也就是线圈内发生的衰减振荡的波形，他可同时判断该绕组的电感、品质因素、绕组的圈数差及匝间短路情况，在有铁芯的情况下，还可以判断其材质的差别等。在施加高压脉冲的情况下，电晕放电的发生还可以对绝缘不良进行判断。总之，标志线圈品质的各个要素，可以在极短时间内检查完成。

本厂生产的 YD2882-5/5A 系列脉冲式线圈匝间测试仪，采用微型计算机技术把波形的各种参数量化处理，再用直观的波形进行显示和判断，操作简单，判断准确，自动化程度高。该仪器体积小，重量轻，便于携带。

1.2 原理说明

1.2.1. 层间短路测试原理

层间短路测试能够在不损坏被测件的条件下测试其电气性能，首先条件是能在短暂的瞬间判别线圈的品质。测试时与标准线圈测量时同样的脉冲通过电容器施加于被测试线圈，由于线圈电感量和 Q 值的存在，将响应一个对应于该放电脉冲的电压衰减波形，比较该衰减波形的某些特征，可以检测线圈匝间和层间短路及圈数和磁性材料的差异，也可以根据出现的电晕或层间放电来判断绝缘不良。

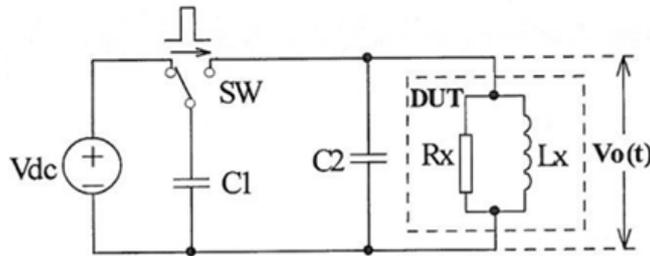


图 1.2.1-1 线圈层间短路测试原理简图

图 12.1-2 中的自激振荡衰减波形直接和线圈的电感值 L 及品质因素 Q 值有着密切的关系，而 L 值及 Q 值又和线圈的圈数、制造工艺、是否空心线圈并且还还与铁芯材料特性又有着不可分割的牵连，施加电压又是高压脉冲电压，因此，当线圈有短路、匝间局部短路或由于绝缘损伤引起的层间或匝间放电现象自然很容易被发现。

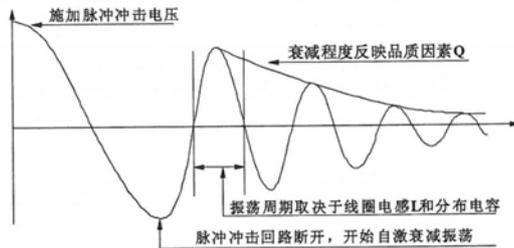


图 1.4.1-2 线圈衰减振荡波形分析

1.2.2 仪器原理框图

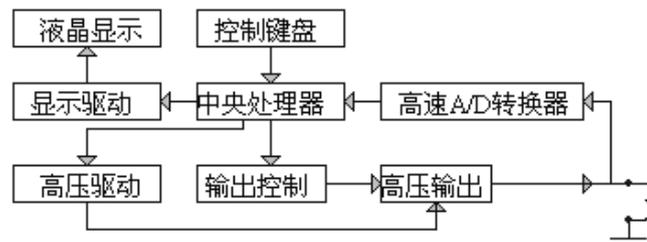


图 1.3.2 工作原理框图

1.2.3 仪器工作原理

YD2882-5/5A 系列脉冲式线圈匝间测试仪以 MCU 中央信息处理系统为核心,由它控制高压脉冲发生器对线圈施加一次极短时间的高压脉冲,线圈在脉冲作用下产生自由衰减振荡,其瞬态波形的模拟信号经高速 A/D 转换器转换成数字信号后反馈至 MCU 信息处理系统进行时间、电晕量、面积、相位等参数的运算,处理结果保存在 MCU 信息处理系统的电子存储器中,并用直观易懂的文字、数据及图形显示在 240×320 点阵液晶模块 LCM 上,从而保证了波形重现的真实性。并且根据用户设定的条件,对合格或不合格者进行报警处理。

1.3 线圈质量检查判断方法

YD2882-5/5A 系列脉冲式线圈匝间测试仪有 4 种典型的自动检查判断方法,用户可以根据被测线圈的实际情况,组合或单独采用;每一种判断方法,均可任意设定、修改临界判断门限,以达到正确、快速检查判断不同线圈品质优劣的目的。具体检查判断方法如下:

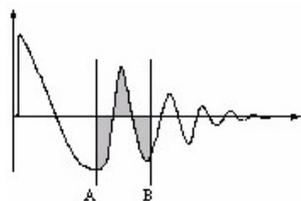


图 1.3.1: 波形面积比较

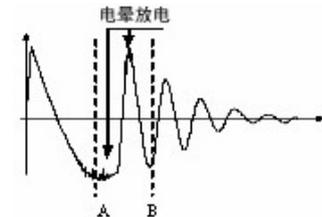


图 1.3.2: 波形电晕量比较

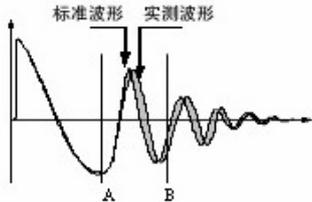


图 1.3.3: 波形面积差比较

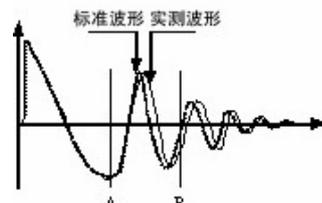


图 1.3.4: 波形相位比较

1.3.1 波形面积比较 (AREA SIZE)

在任意指定的区间内,对标准线圈和被测线圈波形面积进行比较。

如图 1.4.1 所示,计算出 A-B 区间内的面积,判定两者面积相差的程度。

判定的标准用百分比 (%) 进行设定,计算结果在范围内的为合格品。

区间内面积的大小,大体与线圈内能量损耗成比例,故能以此判断能量损耗的大小。

例如被测线圈有匝间短路时,短路部分的反映是能量的损失增大。

1.3.2 波形差面积比较 (DIFFERENTIAL AREA)

在任意指定区间内，对标准线圈和被测线圈波形偏差部分的面积与标准线圈波形面积进行比较。如图 1.4.2 所示，计算出 A-B 区间内面积差，对比标准波形（同图 1.3.2_1）判定偏差的程度。判定的标准用百分比（%）进行设定，结果在范围内的为合格品。波形偏差面积的大小表示电感值以及能量损耗程度的总和。此方法可较全面地检查线圈的电感 L 值及能量损失。

1.3.3 波形电晕量比较 (FLUTTER VALUE)


在任意指定的区间内，对被测线圈的电晕放电量与设定值进行比较。如图 1.4.3 所示，基本忽略波形差异，在任意指定的 A-B 区间内，仅在被测线圈实测波形包含的电晕放电尖峰中检出高频成分进行面积（积分）计算，并将计算结果与设定值进行比较，判定电晕放电量是否合格。可以认为该量是模拟方式中检出的通过高频滤波器的量值。

1.3.4 波形相位（过零点）比较 (ZERO CROSS)

在任意指定的区间内，对标准线圈和被测线圈波形振荡周期进行比较。如图 1.4.4 所示，任意指定的 A-B 区间内，计算被测线圈实测波形在该区间内的振荡周期，并与标准波形在该区间内的振荡周期进行比较，并用这两个量的百分比作为判定依据，基准用百分比来设定。由于波形的振荡周期与线圈的电感 L 密切相关，此方法可偏重于检查线圈的电感 L 值。

第二章 面板说明

2.1 前面板示意图

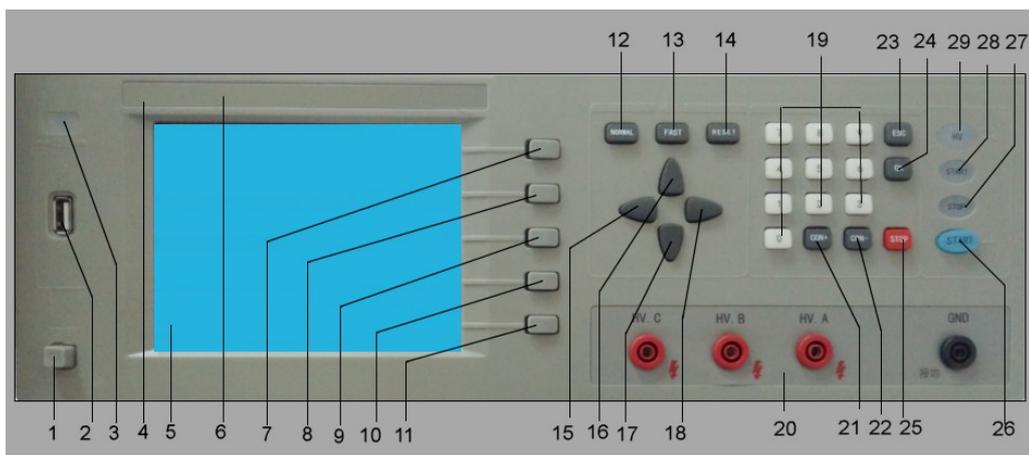

2.2 前面板说明


前面板由功能按键、启动/停止按键、液晶调节按键、液晶显示器、电源开关、设定按键、被测端口等组成。

1. (1) 电源开关：ON/OFF

2. (2) USB 接口(备用)
3. (3) 远控指示灯或保存按钮(备用)
4. (4) 仪器商标、名称
5. (5) 液晶显示器：320x240 点阵液晶，白色显示，蓝色背景，用于波形及参数显示。
6. (6) 仪器型号及名称：
7. 功能按键：
 - (7) **测试** 键——转入测试状态，测试线圈品质
 - (8) **参数** 键——转入参数状态，选择载入、清除、全部清除标准波形及参数
 - (9) **编辑** 键——转入编辑状态，编辑并保存标准波形及其测试条件、判断条件等
 - (10) **查询** 键——转入查询状态，查询标准波形的测试条件、判断条件及输出结果
 - (11) **系统** 键——转入系统状态，系统相关参数设置
8. 菜单键：
 - (12) **NORMAL** 按钮：基本测试（默认）
 - (13) **FAST** 按钮：快速探查
 - (14) **RESET** 按钮：微机复位
9. 光标键盘：光标移动键，移动光标与调节参数
 - (15) **←**：光标向左键
 - (16) **▲**：光标向上键、参数+
 - (17) **▼**：光标向下键、参数-
 - (18) **→**：光标向右键
10. 数字键盘：
 - (19) **0~9** 数字键盘（备用）
11. (20) 测试端口



YD2882-5A 型：
 高压输出端：HV. A、HV. B、HV. C
 接地端：GND

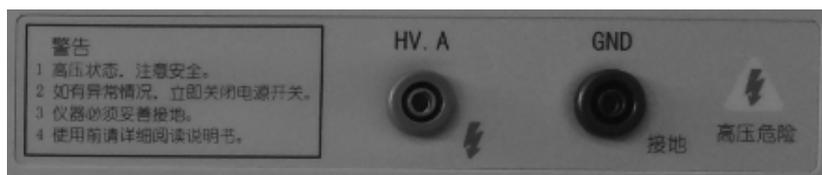

YD2882-5 型：
 高压输出端：HV. A
 接地端：GND

12. 液晶对比度调节按键：
 - (21) 液晶对比度 **CON+** 增强调节键——增强液晶对比度
 - (22) 液晶对比度 **CON-** 减弱调节键——减弱液晶对比度
13. 设定按键：
 - (23) **ESC** ——退出键
 - (24) **OK** ——确认键
14. 启动/停止按键：
 - (25) 停止 **STOP** 键——测试复位
 - (26) 启动 **START** 键——测试启动
15. 状态指示灯：
 - (27) 停止 **STOP** 指示灯（仪器处于待测状态）
 - (28) 启动 **START** 指示灯（仪器处于测试状态）

(29) 高压 HV 指示灯 (仪器处于高压运行状态)

液晶显示分 3 个区:

功能选择区: 对应脉冲式线圈匝间测试仪的五种基本操作:

测试: 进入测试状态:

参数: 选择加载、清除已存储的标准参数及波形;

编辑: 设定标准波形测试条件及判断标准, 保存标准波形及其参数;

查询: 查询参数设置及测试现场输出结果;

系统: 仪器网格模式、声响模式、测试模式、按键音、语言模式等选择与设置;

波形显示区: 显示标准、实测波形及其测试结果。

横坐标: 时间; 纵坐标: 脉冲电压幅度值;

参数区: 用于参数的显示或修改。

2.2 后面板示意图




2.4 后面板说明

1. (32) 脚控连接端口 FOOT C.
2. (33) 散热风扇
3. (34) 安全(机壳)接地端
4. (35) 交流电源插座 (220VAC 50Hz)
5. (36) HANDER 分选控制接口
6. (37) RS232C 通讯接口

2.5 HANDLER 分选接口说明

2.5.1 关于 HANDLER 接口引脚功能图

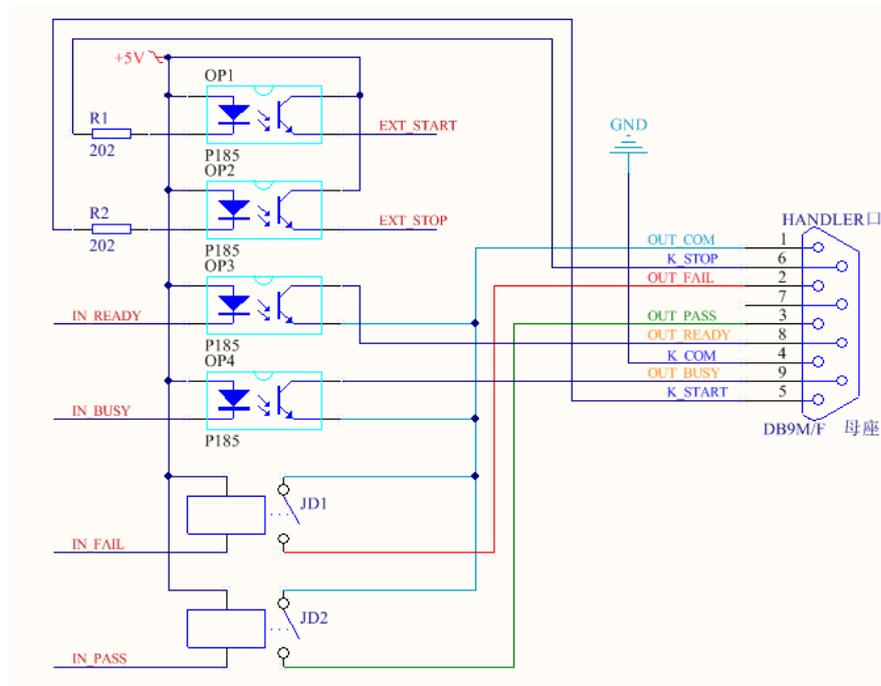

2.5.2 关于 HANDLER 接口说明

DB9-1	OUT_COM	测试结果输出继电器开关——公共端。
DB9-2	OUT_NG	测试结果输出继电器开关——不合格端（常开）。
DB9-3	OUT_GO	测试结果输出继电器开关——合格端（常开）。
DB9-4	K_COM	模拟面板开关——公共端。
DB9-5	K_START	模拟面板开关——启动端（闭合触发启动）。
DB9-6	K_STOP	模拟面板开关——停止端（闭合触发停止）。
DB9-7	NC	空
DB9-8	OUT_READY	测试准备好（常闭）。
DB9-9	OUT_BUSY	测试运行中（常开）。

2.6 RS232C 通讯接口说明

信号缩写	连接器	引脚号	备注
发送数据	TXD	2	与 PC 连接注意 2、3 脚为交叉线。波特率 9600、数据位 8、停止位 1、校验位无。
接收数据	RXD	3	
接地	GND	5	

第三章 注意事项

3.1 安全使用注意事项

为了保证本仪器的安全使用，请务必遵守以下事项。若不注意接触会触电、引起死亡或重伤。

3.1.1 使用注意事项

1. 仪器应该良好接地。请将本仪器后面板安全接地端子进行可靠接地。
2. 请不要用手触摸机器内部。本仪器内部存在高电压，谨防高压触电。
3. 测试状态下且停止灯未亮时，不要接触测试端头及被测线圈，谨防高压触电。
4. 更换测试绕组时，必须在停止灯亮时进行，完毕后方可启动键（或由外部设备给出“START”信号）进行测试。
5. 超过被测试物的极限电压进行测试非常危险。
6. 仪器应该在 20℃~30℃ 的环境中使用，并保证仪器周围通风良好。
7. 由于仪器使用高电压，请回避高湿度、多尘埃的地方。
8. 仪器断电清洁时，请使用水或者沾有少量中性洗涤剂的柔软布料进行擦拭。
9. 请使用具有良好接地性能的三眼电源插座供电。

3.1.2 仪器开机注意事项

高压测试端头可靠的连接到测试卡具上，把电源连接到电源插座上，打开电源开关，仪器液晶显示屏被点亮并且伴有报警声，仪器进入初始化界面，两秒后仪器自动进入待测状态。

3.2 声响方式使用注意事项

仪器工作时，声响方式为合格声响、不合格声响、静音之其中一种。

冲击次数单次 EXT（0~15 次）方式下：

1. 合格声响：只有测试结果合格时有声响。次数到停止测试时，若测试结果合格则有长音声响，需按停止键 1 次关闭。
2. 不合格声响：只有测试结果不合格时，停止测试并有长音声响，需按停止键 1 次关闭。
3. 静音：测试结果合格、不合格均不响。

冲击次数连续（>16 次）INT 方式下：

1. 合格声响：只有测试结果合格时有单短音声响。
2. 不合格声响：只有测试结果不合格时有单短音声响。
3. 静音：测试结果合格、不合格均不响。

测试界面，测试完成时，按停止键 1 次，终止报警声；按停止键 2 次，复位到待测状态。

第四章 基本操作说明

仪器基本测试方式

4.1 测试

基本测试方式：

开机默认方式。

按下 $\boxed{\text{基本测试}}$ 键，仪器工作于**基本测试**方式。

4.1.1 普通线圈测试模式

对被测线圈进行测试。

液晶显示器的波形显示区右上角显示“NORMAL”字符表示默认的常规模式。

1. 任何时候按下 $\boxed{\text{测试}}$ 键，“测试”字符高亮（即白底蓝字）仪器进入**待测状态**。

载入的为上一次测试时的标准波形及其参数。若需更换标准波形及其参数，请先进入**参数状态**加载相应编号的标准波形及其参数；或进入**编辑状态**重新编辑标准波形及其参数。

测试状态下， $\boxed{\text{ESC}}$ 键可用作显示刷新确认。

2. 将高压测试端头可靠地连接到被测线圈两端。

3. 按下 $\boxed{\text{启动}}$ 键（或由外部设备给出“START”信号）仪器测试启动。

每测试一次液晶显示器即显示测试波形及其判断结果。

冲击次数设定为1~9范围时，测试结果若有不合格或测试次数到时仪器停止测试，进入**待测状态**。冲击次数设定为连续INT方式时，仪器连续测试。只有按下 $\boxed{\text{停止}}$ 键时，仪器停止测试，进入**待测状态**。

4. 测试结果的显示方法：

对已选择的判断项全部合格时，显示“合格”。若有一项不合格时显示“不合格”，参数高亮显示。对已选择的判断项显示计算结果，未选择的判断项显示“OFF”。详细信息可进入**查询状态**下进行查询。

“A”代表“AREA SIZE”： 面积比较

“D”代表“DIFF AREA”： 面积差比较

“F”代表“FLUTTER VALUE”： 电晕放电电量比较

“C”代表“ZERO CROSS”： 相位比较

5. HANDER 控制口方式时，对于多绕组的线圈测试，在一个绕组测试完毕，需由外部设备给出“READY”信号置位，退出测试，方可启动另一绕组的测试。

6. 出现不合格绕组时（不合格声响方式），伴随有声光报警，按下 $\boxed{\text{停止}}$ 键（或由外部设备给出“STOP”信号），报警结束，并准备下一次测试。

7. 任何时候按下 $\boxed{\text{停止}}$ 键（或由外部设备给出“STOP”信号），仪器停止测试，进入**待测状态**。

4.1.2 快速测试模式（普通线圈、三相电机）

00号存储单元为快速测试模式特定单元。快速测试模式下，按 $\boxed{\blacktriangle}$ 、 $\boxed{\blacktriangledown}$ 键，改变冲击电压；按 $\boxed{\blacktriangleleft}$ 、 $\boxed{\blacktriangleright}$ 键，不同采样频率的波形会显示在波形显示区，当出现理想波形后，只要按下 $\boxed{\text{OK}}$ 键，当前波形方可被存储为标准波形。

4.1.2.1 普通线圈快速测试模式

1. 载入 00 号存储单元（快速测试专用）的设置，仪器进入快速测试待测状态。
2. 连接好被测线圈绕组。
3. 按下启动键（或由外部脚踏开关给出“START”信号）仪器测试启动。按▲、▼键，改变冲击电压；按◀、▶键选择采样频率。
4. 按下OK键，当前波形被存储为标准波形。
5. 其他基本操作参照 4.1.1 普通线圈测试模式。

4.1.2.2 三相电机快速测试模式

1. 载入 00 号存储单元（快速测试专用）的设置，仪器进入快速测试待测状态。
2. 连接好三相电机绕组中任意一组线圈。
3. 按下启动键（或由外部脚踏开关给出“START”信号）仪器测试启动。按▲、▼键，改变冲击电压；按◀、▶键选择采样频率。
4. 按下OK键，当前波形被存储为标准波形。
5. 再依次接上另外二组线圈分别进行测试。基本操作参照 4.1.1 普通线圈测试模式。

4.1.3 外部 RS232 多绕组型测试模式（*选项）

对多绕组线圈进行测试。需外部三相/单相转换器（YD222-3D/YD222-4A）配合使用。

1. 当 RS232 附件（多通道转换器）插上时，仪器自动进入 RS232 附件测试模式。液晶显示器的波形显示区右上角“NORMAL”字符改显外部“RS232T/S/C”附件模式字符。
2. RS232 附件多绕组测试模式时，相关存储单元按照相应 RS232 附件要求调入。若相关存储单元组中有绕组单元没有编辑过，则需先进入编辑状态，对系列该绕组进行编辑操作。[即：此时按下编辑键转入编辑状态，再按下▼光标键至波形选择（采样频率 SF），调节◀、▶光标键至波形选择参数处，调节▲、▼光标键，不同采样频率的波形会显示在波形显示区，当出现理想波形后，再按下OK键保存并退出至待测状态。相关单元（绕组）重复此操作。]
3. RS232 附件测试模式时，标准波形及参数按外部 RS232 信号进行控制和调入，并进行测试。RS232 附件功能及操作按其附件具体说明书进行。
4. 其他基本操作参照 4.1.1 普通线圈测试模式及 4.1.2.1 普通线圈快速测试模式。

4.1.4 外部 PC 机测试模式（*选项）

1. 此项为选项。具体控制协议见《PC 机控制信号说明》。
2. 当外部 PC 机 RS232 端口连接上并打开 PC 控制时，仪器自动进入 PC 机控制测试模式。液晶显示器的波形显示区右上角显示“PC”模式字符。
3. PC 机控制测试模式时，相关存储单元及参数按照相应 PC 机控制信号要求调入。

4.1.5 内部多绕组测试模式

详见 4.5 系统——测试模式。绕组 HV 端需按照 A->B->C->D 的顺序连接；公共端接地。

特别注意：多绕组测试时，必须先编辑好相关绕组测试参数及标准波形。

自动模式时，启动测试后，仪器会按顺序依次测试相关绕组。前一绕组合格时，转入测试下一绕组；不合格时，仪器状态停在相应绕组并报警。其他基本操作参照 4.1.1。

手动模式时，仪器可通过▲、▼光标键选择前后相邻绕组进行测试。其他基本操作参照 4.1.1。

4.1.6 脚控(FOOT CONTROL)使用

1. 当脚控连接好时，外部脚控优先，面板启动键被屏蔽。取消脚控连接，面板启动键恢复。
2. 测试状态下，当脚控踏下时，其功能相当于面板启动键，但只有当脚控放开后，第二次启动方才有效。

1. 测试状态下，当脚控放开时，其功能相当于面板**停止**键。

4.1.7 快速探查方式

快速探查方式：

主要用于线圈绕组故障位检修快速探查。按下**快速探查**键，仪器工作于**快速探查**方式。

快速探查方式时，仪器有ABC、AB、AC、BC、A、B、C绕组等7种测试模式，液晶显示器显示相应绕组测试波形及面积差比较值。

按下**启动**键，仪器将输出连续的高频脉冲。按下**停止**键时，仪器停止测试。

快速探查方式时，仪器只能进行ABC绕组测试模式切换和冲击电压及采样频率参数等修改。

1、三绕组对比测试：

按下**快速探查**键，选ABC模式，液晶显示器右上角显示"模式：ABC"。

a)将三绕组公共端接地，其余端依次接HV.A、HV.B、HV.C；

b)选择好冲击电压和合适的采样频率，按OK键暂存；

c)按下**启动**键，仪器自动按A->B->C顺序依次循环测试。液晶显示相应波形及其相应波形面积差百分比值。（AB：xxx%表示A绕组与B绕组波形面积差百分比值、AC：xxx%表示A绕组与C绕组波形面积差百分比值、BC：xxx%表示B绕组与C绕组波形面积差百分比值）

d)按下**停止**键时，仪器停止测试。

2、两绕组对比测试：

按下**快速探查**键，选AB/AC/BC模式，液晶显示器右上角显示"模式：AB/AC/BC"。

a)将两绕组公共端接地，其余端依次接HV.A、HV.B/HV.A、HV.C/HV.B、HV.C；

b)选择好冲击电压和合适的采样频率，按OK键暂存；

c)按下**启动**键，仪器自动按A->B/A->C/B->C顺序依次循环测试。液晶显示相应波形及其相应波形面积差百分比值。（AB：xxx%表示A绕组与B绕组波形面积差百分比值、AC：xxx%表示A绕组与C绕组波形面积差百分比值、BC：xxx%表示B绕组与C绕组波形面积差百分比值）

d)按下**停止**键时，仪器停止测试。

3、单绕组定向测试：

按下**快速探查**键，选A/B/C模式，液晶显示器右上角显示"模式：A/B/C"。

a)将单绕组一端接地，另一端接HV.A/HV.B/HV.C；

b)选择好冲击电压和合适的采样频率，按OK键暂存；

c)按下**启动**键，仪器自动对A/B/C绕组进行循环测试。液晶显示相应波形及其相应波形面积差百分比值。

d)按下**停止**键时，仪器停止测试。

4.2 参数

调出或清除已经存储过的波形及参数。

1. 任何时候按下**参数**键，仪器进入**参数状态**。

其中：

No	——编号
NAME	——代号
HV	——脉冲电压
SF(ST)	——采频率样（周期）
PLS	——冲击脉冲次数
A	——面积判别
D	——面积差判别

F ——电晕放电量判别

C ——相位判别

2. 移动 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，选定**载入**、**选清**、**全清**软键功能。

载入：加载所选择编号波形（反白显示）。

选清：删除所选择编号波形（反白显示）。

全清：删除所有存储波形（不含 00 单元），需慎重操作。

3. 移动 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，选定编号，按 **OK** 键确认，该波形被选定或清除，在**载入**软键功能时退出并转入**待测状态**；按 **ESC** 键直接退出，不选定任何波形，并且转入**待测状态**。慎用全清功能。

4. 退出：移动光标到“退出”处，按下 **OK** 键退出并转入**待测状态**。

5. 00 号存储单元为**线圈标准快速采集专用**单元，多用于三相电机测试。

01~99 存储单元为通用线圈存储单元。

4.3 编辑

4.3.1 标准波形及参数编辑

对某一种线圈的测试，首先要根据测试模式（通用线圈或三相电机）进行标准线圈的波形采集，并且依此为根据来判断其它线圈的优劣。

任何时候按下**编辑**键，仪器进入**编辑状态**。

当设定项目高亮（反白）时，调节 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键转入相应设定项目—编号、冲击电压、采样频率、幅度设置、冲击次数、面积比较、面积差比较、电晕量比较、相位比较、多样品标准采集。

1. <00 单元设置>：

a) 设定编号：

调节 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，移动光标到设定编号 No 指示处，通过 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键设定标准波形编号值， \leftarrow 、 \rightarrow 光标键移到下一项时，所设定方式被确认。

00 编号的存储单元为**线圈标准快速采集专用**存储单元。01~99 编号的存储单元为通用线圈存储单元。05 为单相电机多绕组起始存储单元。

b) 设定名称：

调节 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，移动光标到设定名称 NAME 指示处，通过 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键选择 0~9 数字或 A~Z 英文字符， \leftarrow 、 \rightarrow 光标键移到下一项时，所设定方式被确认。

名称由 8 位 0~9 数字和（或）A~Z26 英文字符组成。每一位字符选择同上。

c) 标准波形及参数的储存

按 **ESC** 键，仪器不保存当前操作并退出至**待测状态**。

按 **OK** 键，仪器保存当前操作并退出至**待测状态**。

本仪器最多可以存储 100 个标准波形及参数。

2. 设定测试条件：

a) <01 消磁脉冲>Pluse 值：

调节 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，移动光标到设定名称 Pluse 指示处，通过 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键设定脉冲冲击次数 0~16 次，当 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键移到下一项时，所设定数字被确认。

b) <02 测试脉冲>Pls：

调节 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，移动光标到测试脉冲 PLS 参数处，通过 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键设定脉冲冲击次数 0~9 次和 INT 连续，当 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键移到下一项时，所设定数字被确认。

脉冲冲击次数设定范围是 1~9 次，当超过 9 次时，冲击次数为连续 INT。（连续方式时，按下**停止**键，仪器即可停止测试并进入待测状态。）

c) <03 冲击电压>HV 值：

调节 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，移动光标到 HV 电压参数处，相应数字被选中（高亮），用 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键调

节电压到所需电压值，、光标键移到下一项时，所调节数字被确认，同时采样标准波形。

d) <04 采样频率>SF 值:

调节、光标键，移动光标到采样频率 SF（采样周期 ST）参数处，测试仪进入**采样频率选择状态**。

调节、光标键，不同采样频率的波形会显示在波形显示区，当出现理想波形后，当、光标键移到下一项时，所选波形被确认。

e) <05 幅度调整>Amp:

调节、光标键，移动光标到脉冲幅度 Amp 参数处，通过、光标键设定脉冲幅度参数，当、光标键移到下一项时，所设定数字被确认。注意：推荐仅在波形幅度过低时调节。

3. 设定判断条件:

线圈质量检查判断有 4 种方法。

四种判断方法可以组合使用，也可以单独使用。当选用某种方法时，其选择标记为□（或“Y” YES）；当禁用某种方法时，其选择标记为：×（或“N” NO）。选择时，光标移至选择标记处，通过调节、光标键在□、×之间切换。、光标键移到下一项时，所选标记被确认。

设定判断方法中进行数字调整时，除有数字指示外，在波形上还有游标指示，使调节更加形象直观。

a) <06 面积比较>（AREA SIZE）:

通过比较波形与中线所包围的面积差异来判断测试波形与标准波形的重合程度。

对应面积比较（A）第一个参数：判断的起点；第二个参数：判断的终点；第三个参数：差异范围，单位：百分比%。

参数的数值调节方法同电压调节。

测试时，脉冲式线圈匝间测试仪对设定范围内的波形面积进行比较，超出差异范围设定值则不合格。

b) <07 积差比较>（DIFFERENTIAL AREA）:

通过标准波形与测试波形所包围的面积与标准波形面积的值来判断与标准波形的重合程度。

对应面积差比较（D）第一个参数：判断的起点；第二个参数：判断的终点；第三个参数：差异范围，单位：百分比%。

数字的调节方法同电压调节。

测试时，脉冲式线圈匝间测试仪根据测试波形与标准波形的差异来计算面积差，当面积差与标准波形的面积比值超过设定值则不合格。

c) <08 电晕比较>（FLUTTER VALUE）:

通过对被测线圈选定范围内实测波形包含的电晕放电尖峰中所检出高频成分面积（积分）的计算，并将计算结果与设定值进行比较，判定电晕放电量是否合格。

对应电晕量比较（F）的第一个参数：判断的起始点；第二个参数：判断的终止点；第三个参数：差值范围。数字的调节方法同电压调节。

通过对被测线圈波形包含的电晕放电尖峰中所检出高频成分面积（积分）的计算，并将计算结果与设定值进行比较，当差值范围超过设定值则不合格。

d) <09 相位比较>（ZERO CROSS 过零点比较法）:

通过对过零点的位置差异来判断与标准波形的重合程度。

对应相位比较（C）第一个参数：所选定的过零点；第二个参数：差值范围，单位为采样点数。

数字的调节方法同电压调节。

液晶显示波形第一个过零点为电容放电的过零点，第二个过零点为线圈的自激振荡，所以设定条件应从第二过零点开始，测试时，当所测试的线圈过零点的位置超过设定值则不合格。

4. 标准波形修改:

a) 从载入处选择要修改的波形编号并确认，转入**待测状态**。

进入**编辑状态**，进行编辑操作。

4.3.2 极性选择（音圈）

<10 极性选择>：（*YD211SP 选项）

适用于音圈的极性测试。

连接好极性测试传感器（YD223-1A），夹好被测样品。

调节 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，移动光标到 Pol 处，通过 \uparrow 、 \downarrow 光标键选择+极性或-极性作为标准；调节 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，移动光标到 \square 、 \times 处，通过 \uparrow 、 \downarrow 光标键选择 \square （或“N” NO）或 \square （或“Y” YES）；当按下 \square 键时，设置有效。

4.3.3 多标准样件的标准采集

<11 多样平均>：

多样品标准采集。夹好被测样品，调节 \leftarrow 、 \rightarrow 光标键，移动光标到相应样品编号处，通过 \uparrow 、 \downarrow 光标键采集相应编号标准波形，当按下 \square 键时，所采集相关样品数据平均值被确认。标准样品最多可采集 10 组。**注意：**采集标准波形前，相应标准样品必须连接有效。此项一般不用，忽略。

4.4 工具

按下 \square 键 1 次，仪器进入**查询状态**。

1. 查询当前标准波形的参数设置。
2. 查询当前被测波形及其与标准波形的比较结果（最后一绕组）。
3. 按 \square 键或 \square 键返回**待测状态**。

按下 \square 键 3 次，仪器进入**调试界面**。（工厂调试用）

4.5 系统

按 \square 键 1 次，仪器进入**系统设置**界面；按 \square 键 2 次，仪器进入**关于**界面（厂商信息）；

系统设置

设置系统相关参数。

用 \uparrow 、 \downarrow 、 \leftarrow 、 \rightarrow 键改变设置项及其参数，反白为选中。

1. 网格模式：标准网格（50 点/格 默认）、零位线、无网格、密网格（25 点/格）
2. 声响模式：不合格响（默认）、合格响、静音
3. 判断模式：不合格终止、不合格继续
4. 测试模式：（*YD2882-5 机型默认 NORMAL 模式）
5. 按键声音：ON(打开)、OFF(关闭)
6. 语言选择： 0 中文 1 英文
7. 设备地址： 1~99
8. 波特率： 0-9600 1-19200 2-38400 3-57600
9. 校验模式： 0 无校验 1 异或校验 2 累加和校验 3 CRC
10. 波形传输： 0 关闭(可被动读取) 1 打开(主动发送)


按 \square 键所有设置方可有效保存。

按 \square 键不保存直接返回**待测状态**。

关于

软件功能、版本号、厂商信息

内部多绕组测试模式接线图：（接线图 COM 端对应仪器 GND 端）


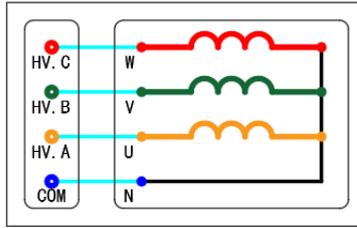


AUTO3Y(三相四线, 即对称 3 绕组 4 线) 接线图

存储编号: 除已经成组使用编号以外的任意编号。推荐使用 000 编号

测试顺序: AG: BG、 BG: CG、 CG: AG

被测品 AG、BG、CG 绕组直接两两对比

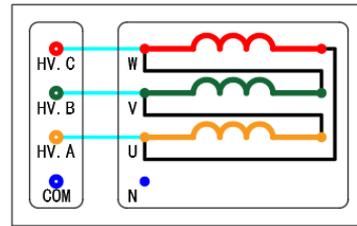
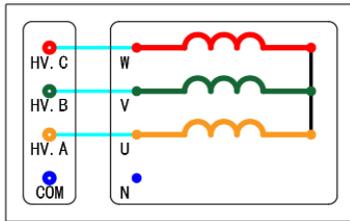


AUTO3V(三相三线, 即对称 3 绕组 3 线) 接线图

存储编号: 除已经成组使用编号以外的任意编号。推荐使用 000 编号

测试顺序: AB: AC、 BA: BC、 CA: CB

比较方式: 被测品 AB、AC、BC 绕组直接两两对比

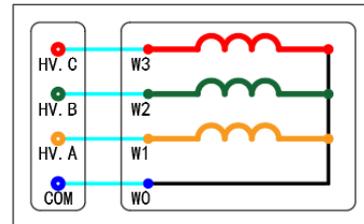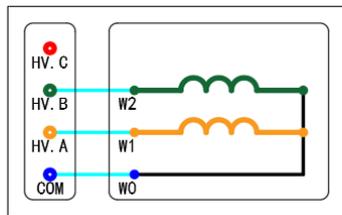

AUTOS2(对称或不对称 两组三线) 接线图

AUTOS3(对称或不对称 三组四线) 接线图

存储编号组: 1-2-3、4-5-6、7-8-9……91-92-93、94-95-96、97-98-99（每组存储前 2 编号）




存储编号组: 1-2-3、4-5-6、7-8-9……91-92-93、94-95-96、97-98-99（每组存储 3 编号）

测试顺序: AG、BG

测试顺序: AG、BG、CG

比较方式: 被测品与标准件对应绕组对比

比较方式: 被测品与标准件对应绕组对比

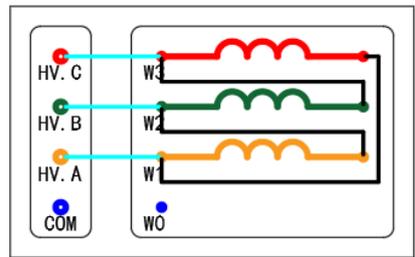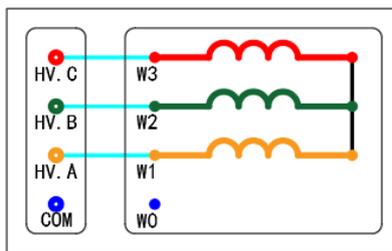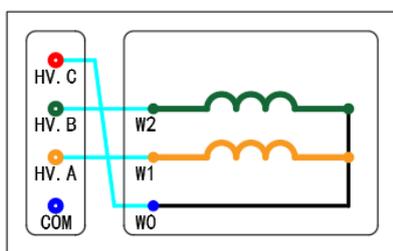

AUTOAB(对称或不对称 两组三线、对称或不对称 三组三线) 接线图

存储编号组: 1-2-3、4-5-6、7-8-9……91-92-93、94-95-96、97-98-99（每组存储 3 编号）

测试顺序: AB、 AC、 BC

比较方式: 被测品与标准件对应绕组对比

提示: 最简采样操作——1 连接标准件 - 2 编辑(编号 - 启动 - OK 保存) - 3 测试

第五章 测试操作说明

5.1 单绕组(单线圈)测试

本测试方式适用于 YD2882-5 机型。

5.1.1 连接被测产品。

将标准线圈或被测试线圈两端分别连接到高压输出端 **HV (HV. A)** 和接地端 **GND**。

5.1.2 选择测试模式。

YD2882-5 机型按 **系统** 键，然后按 **▼** 光标键到 **测试模式**，然后按 **▶** 光标键，按 **▲**、**▼** 光标键选择 **NORMAL** 测试模式。按 **▶** 光标键，按 **▼** 光标键到 **保存**，最后按 **OK** 键确认测试模式。

YD2882-5 为单绕组测试型，不用选择此项。

5.1.3 编辑标准参数及波形。

按 **编辑** 键，进入 **编辑模式**。将标准线圈连接于被测端。

通过 **◀**、**▲**、**▼**、**▶** 光标键，移动光标及调节参数。

编辑项次	设置注意事项
00 单元设置 编号 000 名称 XXXX	编号可设 000~099 默认 000 名称根据需要，可不改动
01 消磁脉冲 00	被测品有剩磁现象时可设置 1~16 次，否则置 0。
02 测试脉冲 PL: 02	生产现场一般设 1~3 次。计量和维修线圈时可设为连续。
03 冲击电压 HV: 1000V	按被测产品要求设定（一般 1000V+2 倍额定电压）。 可参考被测产品漆包线绝缘耐压。
04 采样频率 SF: 20MHz/ 02	一般选择 3~6 个峰值。 若峰值少，把尾部近零位线部分移除到屏幕外边即可。
05 幅度调整 AMP: 40	默认即可，不用调节。
06 面积比较 A:000-250 10%	只需修改百分比值，即产品一致性公差许可范围。 根据批量合格品确定公差许可范围。

设置完上述内容，按 **OK** 键确认保存相关设置参数及标准波形。返回测试界面，进入待测状态。

5.1.4 管理标准参数及波形。

按需要选择需要加载或删除的相关标准参数及波形。按 **▶** 光标键，按 **▲**、**▼** 光标键选择，按 **OK** 键确认。

5.1.5 测试。

1、将被测线圈连接于被测端。

2、踏下脚控开关(无脚控开关，按下面板启动 **START** 键)，测试仪 **HV** 高压运行指示灯、**START** 启动指示灯亮，测试进行。

3、测试结束，仪器显示合格或不合格信息并报警。若有不合格项，其百分比值会反白显示。仪器 HANDLER 分选接口会输出相应信号。RS232C 接口会输出测试波形数据及合格不合格信息。

5.2 三相电机绕组测试

本测试方式适用于 YD2882-5A 机型。

5.2.1 连接被测产品。

将标准线圈或被测试线圈输出端按**系统**—**测试模式**分别连接到高压输出端。

三输出端（△或 Y 型三线）形式：**HV (HV. A)**、**HV (HV. B)**、**HV (HV. C)**。

四输出端（Y 型四线）形式：**HV (HV. A)**、**HV (HV. B)**、**HV (HV. C)**和接地端 **GND**。

5.2.2 选择测试模式。

YD2882-5A 机型按**系统**键，然后按**▼**光标键到**测试模式**，然后按**▶**光标键，按**▲**、**▼**光标键选择相应三输出端（△或 Y 型三线）**AUTO3V** 测试模式或四输出端（Y 型四线）**AUTO3Y** 测试模式。按**◀**光标键，按**▼**光标键到**保存**，最后按**OK**键确认测试模式。

5.2.3 编辑标准参数及波形。

按**编辑**键，进入**编辑模式**。将标准线圈连接于被测端。

通过**◀**、**▲**、**▼**、**▶**光标键，移动光标及调节参数。

编辑项次	设置注意事项
00 单元设置 编号 000 名称 xxxx	编号可设 000~099 默认 000 名称根据需要，可不改动
01 消磁脉冲 00	被测品有剩磁现象时可设置 1~16 次，否则置 0。
02 测试脉冲 PL: 02	生产现场一般设 1~3 次。计量和维修线圈时可设为连续。
03 冲击电压 HV: 1000V	按被测产品要求设定（一般 1000V+2 倍额定电压）。 可参考被测产品漆包线绝缘耐压。
04 采样频率 SF: 20MHz/ 02	一般选择 3~6 个峰值。 若峰值少，把尾部近零位线部分移除到屏幕外边即可。
05 幅度调整 AMP: 40	默认即可，不用调节。
06 面积比较 A:000-250 10%	只需修改百分比值，即产品一致性公差许可范围。 根据批量合格品确定公差许可范围。

设置完上述内容，按**OK**键确认保存相关设置参数。返回测试界面，进入待测状态。

5.2.4 管理标准参数及波形。

按需要选择需要加载或删除的相关标准参数及波形。按**▶**光标键，按**▲**、**▼**光标键选择，按**OK**键确认。

5.2.5 测试。

- 1、将被测线圈连接于被测端。
- 2、踏下脚控开关(无脚控开关，按下面板启动**START**键)，测试仪**HV**高压运行指示灯、**START**启动指示灯亮，测试进行。
- 3、测试结束，仪器显示合格或不合格信息并报警。若有不合格项，其百分比值会反白显示。仪器 HANDLER 分选接口会输出相应信号。RS232C 接口会输出测试波形数据及合格不合格信息。

5.3 单相电机绕组测试

本测试方式适用于 YD2882-5 机型。

5.3.1 连接被测产品。

将标准线圈或被测试线圈公共端连接到接地端 **GND**，主绕组端连接到高压输出端 **HV (HV. A)**，副绕组端连接到高压输出端 **HV (HV. B)**。若还有其他副绕组以此类推分别接到高压输出端 **HV (HV. C)**、高压输出端 **HV (HV. D)**。

5.3.2 选择测试模式。

YD2882-5 机型按 **系统** 键，然后按 **▼** 光标键到 **测试模式**，然后按 **▶** 光标键，按 **▲**、**▼** 光标键选择 **AUTOS2** (主副绕组)、**AUTOS3** (主副副绕组)、**AUTOS4** (主副副副绕组) 测试模式。按 **▶** 光标键，按 **▼** 光标键到 **保存**，最后按 **OK** 键确认测试模式。

5.3.3 编辑标准参数及波形。

按 **编辑** 键，进入 **编辑模式**。将标准线圈连接于被测端。

通过 **◀**、**▲**、**▼**、**▶** 光标键，移动光标及调节参数。

编辑项次	设置注意事项
00 单元设置 编号 000 名称 xxxxx	AUTOS2、AUTOS3、AUTOAB 模式时对应存储分配为 3 编号一组 (1-2-3)、(4-5-6)、(7-8-9)、(11-12-13)、(14-5-16)、(17-18-19)…… 其他模式编号任意 (00-99) 00 编号为特殊单元，测试界面可以上下键改变电压，左右键选择采样频率 (波形)，OK 键确认保存。 名称根据需要，可不改动
01 消磁脉冲 00	被测品有剩磁现象时可设置 1~16 次，否则置 0。
02 测试脉冲 PL: 02	生产现场一般设 1~3 次。计量和维修线圈时可设为连续。
03 冲击电压 HV: 1000V	按被测产品要求设定 (一般 1000V+2 倍额定电压)。 可参考被测产品漆包线绝缘耐压。
04 采样频率 SF: 20MHz/02	一般选择 3~6 个峰值。 若峰值少，把尾部近零位线部分移除到屏幕外边即可。
05 幅度调整 AMP: 40	默认即可，不用调节。
06 面积比较 A:000-250 10%	只需修改百分比值，即产品一致性公差许可范围。 根据批量合格品确定公差许可范围。
07 积差比较 A:000-250 15%	同上述方法。

设置完上述内容，按 **OK** 键确认保存相关设置参数及标准波形。返回测试界面，进入待测状态。

5.3.4 管理标准参数及波形。

按需要选择需要加载或删除的相关标准参数及波形。按 **▶** 光标键，按 **▲**、**▼** 光标键选择，按 **OK** 键确认。

5.3.5 测试。

将标准线圈连接于被测端。测试操作同 5.2.5。

第六章 成套与保修

6.1 成套

开箱后，请做如下确认：

1. 产品的外观是否有破损、刮伤等不良现象；产品装箱是否完整。
2. 产品装箱单：

名 称	数量	备注
YD2882-/5/5A 脉冲式线圈匝间测试仪	1 台	
电源线	1 根	
测试线	1 付	
脚踏开关	1 只	
产品合格证	1 张	
使用说明书	1 份	
产品保修卡	1 份	

产品如有破损或装箱不足，请立即与我厂或发货单位联系。

6.2 保修

保修说明

1. 请妥善填写并寄回产品保修卡。
产品保修卡是我们为您提供服务的凭证。我们的服务包括使用指南、故障维修、技术培训、新产品推广及提供其它技术支持等。
2. 我厂产品一律实行三包（不符合使用条件或违反操作规程所致损坏除外）。保修期为二年，一个月内包退包换，终身维修。
3. 保修期以内免费修理，超过保修期按本厂统一的维修收费标准进行收费修理。
4. 保修期从客户实际购买之日（以保修卡的购买日期为准，否则以产品出厂日期为准）算起。
5. 如果对我们（包括经销商）的服务不满意，或者您的正当权益受到损害，可向本厂客服部投诉。

（电话：0519-88226706 ）

以下情况恕不免费修理

1. 因运输造成的损坏。（请与保险公司或运输部门联系解决）
2. 因错误安装或在非产品所规定的工作环境下使用造成的故障或损坏。
3. 擅自拆机修理或越权改装、滥用造成的故障或损坏。
4. 因使用不符合规定的电源造成的故障或损坏。
5. 因不可抗力力造成的故障或损坏。

常州市扬子电子有限公司

2015. 08

附件

附件 1：脉冲式线圈匝间测试仪 通讯协议 V4.0.2

适用于客户对 YD2882-5/5A 系列匝间仪（V400 以上版本）的第三方开发。

RS232C (DB9) 通讯接口说明

功 能		引脚号	备 注
发送数据	TXD	2	与电脑 PC 连接注意 2、3 脚为交叉线。 波特率 9600/19200/38400/57600 可选、数据位 8、停止位 1、校验位无。
接收数据	RXD	3	
接地	GND	5	

RS485 通讯可定制（1-A，2-B，5-G）。

1 串口通讯格式：（收发格式相同 HEX）

```

Adr  Fun  Cmd  Len  Parameter  check  End
----  ---  ---  ---  -----  ----  ----
01   10   02   n    00...      xor   ff
    
```

通讯格式（HEX）说明：

字符	名称	示例	说 明	备 注
Adr	设备地址	0x01	1~247 0x01 匝间仪 (V4.0.0 以上) 0x03 电阻仪	
Fun	功能码	0x03	0x03 读 0x10 写	
Cmd	命令码	0x02		
Len	参数串长度	0x02	按参数串字节个数	
Parameter	参数串	0xXX	对应参数串长度	
			
Check	校验位	0x00	默认无校验 (0x00)。可定制和校验、异或校验、CRC16	
End	帧尾	0xff	固定 (CRC16 时为校验高位字节)	

注：CRC 检验时，Check 对应 CR16C 低位字节，End 对应 CRC16 高位字节

设备地址说明：

设备地址	名 称	说 明	备 注
0x01	匝间仪	YD2882-5/5A 机型，版本 4.0.0 以上。	可设置

1.1 通讯协议格式 (n=1~250)

[0]从地址	[1]功能码	[2]命令码		[3]串长度	[4..n]参数串内容	[n+1..n+2]校验位
0x01	0x03 读取	0x01	仪器信息			
		0x02	被测波形			
		0x03	系统信息			
		0x04	标准参数			
		0x05	标准波形			
		0x06	读参数区			
		0x07	读波形区			
		0x08	读测试结果	32		
		0x09	读测试波形	250		
		0x0a				
		0x0b				
		0x0c				
		0x0d				
		0x0e				
		0x0f				
		0x10	启动发送结果	4	Ms+Ch+No+NG	
		0x11	启动发送结果	32	测试结果判定值	
0x12	启动发送波形	250	测试结果波形			
0x13						
0x14						
0x01	0x10 写入	0x01	初始参数			
		0x02	按键指令			
		0x03	系统信息			
		0x04	标准参数			
		0x05	标准波形			
		0x06	写参数区			
		0x07	写波形区			

1.2 读取命令码格式

[2]		[3]	[4]	[5]	说 明	仪器返回示例	备注
命令码		串长	参 0	参 1			
0x01	仪器信息	1	0x00		读设备 ID 号 8B	"010301 08.....C E"	C=chk E=end
			0x01		读仪器型号 11B	"010301 0b.....C E"	
			0x02		读制造商单位 10B 读制造商电话 26B 读制造商传真 17B	"010301 0a.....C E" "010301 1a.....C E" "010301 11.....C E"	
					参数错误 1B	"018301 01 11 C E"	
0x02	被测波形	1	0x02		读当前被测结果 18B	"010302 12.....C E"	
			0x03		读当前被测波形 250B	"010302 fa.....C E"	250 点
0x03	系统设置	1	0x03		读当前系统设置参数 16B	"010303 10.....C E"	
0x04	标准参数	1	0x03		读当前测试标准参数 64B	"010304 40.....C E"	
0x05	标准波形	1	0x03		读当前测试标准波形 250B	"010305 fa.....C E"	250 点
0x06	读参数区	2	0x03	xx	读存储区标准参数 64B	"010306 40.....C E"	
0x07	读波形区	2	0x03	xx	读存储区标准波形 250B	"010307 fa.....C E"	250 点
0x08	读 结果	2	0x03	ch	测试结果读 ch 通道号 0~3	"010308 12.....C E"	32 字节
0x09	读 波形	2	0x03	ch	测试波形读 ch 通道号 0~3	"010309 fa.....C E"	250 点
.....							
0x10	发送结果	3					
0x11	发送结果	32					
0x12	发送波形	250					

1.3 写入命令码格式

[2]	[3]	[4]	[5]	说明	备注	
命令码	串长	参 0	参 1			
0x01	仪器初始	1	0xff		仪器初始化 (慎用)	
	仪器复位	1	0xfe		仪器复位	
0x02	数据操作	2	0x01	xx	加载 0~99 测试参数 xx 编号 0~99	
		2	0x02	xx	删除 1~99 测试参数 xx 编号 1~99	
		1	0x03		删除 1~99 全部测试参数	
	按键指令	1	0x90			测试界面
			0x91			参数界面
			0x92			编辑界面
			0x93			工具界面
			0x94			系统界面
			0x95			光标-向上 数据增减
			0x96			光标-向下 数据增减
			0x97			光标-向左 光标移动
			0x98			光标-向右 光标移动
			0x99			确认
			0x9a			取消
			0x9b			启动 返回 ch+ngo 测试结果 32B 返回测试波形 250B
			0x9c			停止 终止测试 终止报警声
			0x9d			基本测试
			0x9e			快速探查
0x03	系统设置	10	0x80	xx	写当前系统设置参数(16B) [4]有效 0x80[5]xx 编号 0~99	
0x04	标准参数	40	0x80	xx	写当前测试标准参数(64B) [4]有效 0x80[5]xx 编号 0~99	
0x05	标准波形	fa	0x80	xx	写当前测试标准波形(250B) 接上一指令写入	
0x06	写参数区	40	0x80	xx	写存储区标准参数(64B) [4]有效 0x80[5]xx 编号 0~99	
0x07	写波形区	fa	0x80	xx	写存储区标准波形(250B) 接上一指令写入	

提示： 示例指令串 串尾“00 ff”依据校验模式要求变化
标准参数及波形的读(写)波形指令必须在读(写)参数指令完成后接着读(写)。

2.0 PC 机读取指令

2.1 PC 机发送(读取)指令串

PC 机发送 指令串	说 明	接收代码
"01 03 01 01 01 00 FF"	读设备 ID 号(8B) 转 ASCII 码	RD0101
"01 03 01 01 02 00 FF"	读仪器型号(11B) 转 ASCII 码	RD0102
"01 03 01 01 03 00 FF"	读制造商单位(10B) 转 ASCII 码	RD0103_01
	读制造商电话(26B) 转 ASCII 码	RD0103_02
	读制造商传真(17B) 转 ASCII 码	RD0103_03
"01 03 02 01 02 00 FF"	读当前被测结果(32B)	RD0202
"01 03 02 01 03 00 FF"	读当前被测波形(250B) X 轴(0~249)Y 轴(数据)	RD0203
"01 03 03 01 03 00 FF"	读当前系统设置参数(16B)	RD0303
"01 03 04 01 03 00 FF"	读当前测试标准参数(64B)	RD0403
"01 03 05 01 03 00 FF"	读当前测试标准波形(250B)	RD0503
"01 03 06 02 03 xx 00 FF"	读有效存储区标准参数(64B) xx 编号 0~99	RD0603
"01 03 07 02 03 xx 00 FF"	读有效存储区标准波形(250B) xx 编号 0~99	RD0703
"01 03 08 02 03 xx 00 FF"	读测试结果 32B xx 通道号 0~2 对应 0、1、2 通道	RD0803
"01 03 09 02 03 xx 00 FF"	读测试波形 250B xx 通道号 0~2 对应 0、1、2 通道	RD0903

2.2 接收代码示例:

接收代码	示 例
RD0101 读设备 ID 号 (8B)	收←◆01 03 01 08 30 31 32 33 34 35 36 37 00 FF
RD0102 读仪器型号 (11B)	收←◆01 03 01 0B 59 47 32 31 31 53 2D 30 35 20 00 00 FF
RD0103_01 读制造商单位 (10B)	收←◆01 03 01 0A 48 55 47 55 41 4E 47 20 44 5A 00 FF
RD0103_02 读制造商电话 (26B)	收←◆ 01 03 01 1A 54 65 6C 3A 30 35 31 32 2D 33 36 38 33 39 39 32 38 2F 33 36 38 33 39 38 36 38 00 FF
RD0103_03 读制造商传真 (17B)	收←◆01 03 01 11 46 61 78 3A 30 35 31 32 2D 33 36 38 33 39 39 31 38 00 FF
RD0202 读当前被测结果 32B	收←◆01 03 02 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
RD0203 读当前被测波形 (250B)	收←◆01 03 02 FA C8 4A 1E 17 18 1A 1C 1E 21 24 28 2C 30 34 38 3E 43 48 4E 53 59 5E 64 6A 6F 75 7A 7F 85 8A 8E 93 96 9A 9E A1 A4 A6 A8 AA AB AC AC AD AC AB AA A8 A6 A3 9F 98 91 87 7D 73 68 5C 51 46 3B 31 29 21 1A 15 11 0F 0E 0E 11 14 19 1F 27 2F 39 43 4E 59 64 6F 7B 85 8F 99 A0 A3 A4 A6 A7 A8 A8 A7 A7 A6 A4 A3 9E 99 93 8B 83 7A 71 67 5D 54 4B 42 3A 33 2C 26 23 1F 1D 1D 1D 1F 22 26 2C 32 39 41 49 52 5B 65 6E 77 80 88 90 96 9C A2 A4 A5 A5 A5 A4 A3 A1 9E 9A 94 8D 87 7F 77 6D 65 5C 54 4C 44 3D 36 31 2C 29 26 24 24 25 27 2A 2E 33 38 3F 46 4E 56 5E 67 6F 77 7F 86 8D 93 98 9C 9F A1 A2 A2 A1 9F 9C 98 94 8D 87 80 79 71 69 61 59 51 4A 43 3D 37 32 2E 2C 2A 29 29 2B 2D 30 34 39 3F 45 4C 53 5B 63 6A 72 79 80 87 8D 91 96 99 9C 9D 9E 9D 9C 9A 96 92 8D 87 81 7A 73 6B 64 5D 00 FF
RD0303 读当前系统设置参 数 (16B)	收←◆01 03 03 10 80 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
RD0403 读当前测试标准参 数 (64B)	收←◆01 03 04 40 80 00 1D 2F 00 00 00 00 00 01 0A 10 01 00 FA 0A 01 00 FA 0A 01 40 80 14 00 02 05 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 27 10 00 64 00 64 00 64 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
RD0503 读当前测试标准波 形 (250B)	收←◆01 03 05 FA C8 4B 1E 17 18 1A 1C 1E 21 24 28 2C 30 34 38 3E 43 48 4E 53 59 5F 64 6A 6F 75 7A 7F 85 89 8E 93 97 9B 9E A1 A4 A6 A8 AA AB AC AD AD AC AB AA A8 A6 A3 9E 98 91 88 7D 73 68 5C 51 46 3B 31 29 21 1A 15 11 0F 0E 0E 11 14 19 1F 27 30 39 43 4E 59 64 6F 7B 85 8F 98 9F A3 A4 A6 A7 A7 A8 A8 A7 A6 A5 A2 9E 99 93 8B 83 7A 71 67 5D 54 4B 42 3A 33 2C 27 22 20 1D 1D 1D 1F 22 26 2C 32 39 41 49 52 5B 65 6E 77 80 88 90 97 9C A2 A4 A5 A5 A5 A4 A3 A1 9E 9A 94 8D 86 7F 76 6D 65 5C 54 4C 44 3D 36 31 2C 29 26 25 24 25 27 2A 2E 33 38 3F 46 4E 56 5E 67 6F 77 7F 86 8D 93 98 9C 9F A1 A2 A2 A1 9F 9C 98 93 8D 87 80 79 71 69 61 59 51 4A 43 3D 37 32 2E 2C 2A 29 29 2B 2D 30 34 39 3F 45 4C 53 5B 63 6A 72 79 80 87 8D 92 96 99 9C 9D 9E 9D 9C 99 96 92 8D 87 81 7A 73 6C 64 5D 00 FF

接收代码	示 例
RD0603 读参数区->0~99 读 存储区标准参数 (64B) 有效区	收←◆01 03 06 40 80 00 1D 2F 00 00 00 00 00 01 0A 10 01 00 FA 0A 01 00 FA 0A 01 40 80 14 00 02 05 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 27 10 00 64 00 64 00 64 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
RD0703 读波形区 0~99 读存 储区标准波形 (250B) 有效区	收←◆01 03 07 FA C8 4A 1E 17 18 1A 1C 1E 21 24 28 2C 30 34 38 3E 43 48 4E 53 59 5E 64 6A 6F 75 7A 7F 85 8A 8E 93 96 9A 9E A1 A4 A6 A8 AA AB AC AC AD AC AB AA A8 A6 A3 9F 98 91 87 7D 73 68 5C 51 46 3B 31 29 21 1A 15 11 0F 0E 0E 11 14 19 1F 27 2F 39 43 4E 59 64 6F 7B 85 8F 99 A0 A3 A4 A6 A7 A8 A8 A7 A7 A6 A4 A3 9E 99 93 8B 83 7A 71 67 5D 54 4B 42 3A 33 2C 26 23 1F 1D 1D 1D 1F 22 26 2C 32 39 41 49 52 5B 65 6E 77 80 88 90 96 9C A2 A4 A5 A5 A5 A4 A3 A1 9E 9A 94 8D 87 7F 77 6D 65 5C 54 4C 44 3D 36 31 2C 29 26 24 24 25 27 2A 2E 33 38 3F 46 4E 56 5E 67 6F 77 7F 86 8D 93 98 9C 9F A1 A2 A2 A1 9F 9C 98 94 8D 87 80 79 71 69 61 59 51 4A 43 3D 37 32 2E 2C 2A 29 29 2B 2D 30 34 39 3F 45 4C 53 5B 63 6A 72 79 80 87 8D 91 96 99 9C 9D 9E 9D 9C 9A 96 92 8D 87 81 7A 73 6B 64 5D 00 FF
RD0803 测试结果 (32B)	收←◆01 03 14 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
RD0903 返回测试波形数据 (250B)	收←◆01 03 15 FA C8 4C 1F 17 18 1A 1C 1E 21 24 27 2B 30 34 39 3E 43 48 4D 53 58 5E 64 6A 6F 74 7A 7F 84 89 8E 92 97 9A 9E A1 A4 A6 A8 AA AB AC AD AD AC AB AA A8 A6 A3 9F 99 91 88 7E 73 68 5C 51 47 3B 32 29 21 1A 15 11 0F 0E 0E 10 14 19 1F 27 2F 39 43 4E 59 64 6F 7A 85 8F 98 A0 A3 A4 A6 A7 A7 A8 A7 A7 A6 A5 A2 9E 9A 93 8C 83 7B 71 67 5D 54 4B 42 3A 33 2C 27 22 1F 1D 1D 1D 1F 22 26 2C 32 39 40 49 52 5B 64 6E 76 7F 88 90 96 9C A1 A4 A5 A5 A5 A4 A3 A1 9E 9A 94 8E 87 7F 77 6E 65 5D 54 4C 44 3D 36 31 2C 29 26 25 24 25 27 2A 2D 32 38 3E 46 4D 55 5E 66 6E 76 7E 86 8D 92 97 9C 9F A1 A2 A2 A1 9F 9D 98 94 8E 88 80 79 71 69 61 59 51 4A 43 3D 37 32 2E 2C 2A 29 29 2B 2D 30 34 39 3F 45 4C 53 5B 62 6A 71 79 80 87 8C 91 96 99 9C 9D 9E 9D 9C 9A 96 92 8D 87 81 7A 73 6C 65 5D 00 FF

3.0 PC 机写入指令

3.1 PC 机发送(写入)指令串

PC 机发送 指令串	说 明	接收代码
"01 10 01 01 ff 00 FF"	仪器初始化测试参数 (慎用! 会清空客户存储数据)	WR0101
"01 10 01 01 fe 00 FF"	仪器复位	
"01 10 02 02 01 xx 00 FF"	加载 0~99 测试参数 xx 编号 0~99	WR0201
"01 10 02 02 02 xx 00 FF"	删除 1~99 测试参数 xx 编号 1~99	WR0202
"01 10 02 01 03 00 FF"	删除 1~99 全部测试参数	
"01 10 02 01 90 00 FF"	测试界面	WR0290
"01 10 02 01 91 00 FF"	参数界面	WR0291
"01 10 02 01 92 00 FF"	编辑界面	WR0292
"01 10 02 01 93 00 FF"	工具界面	WR0293
"01 10 02 01 94 00 FF"	系统界面	WR0294
"01 10 02 01 95 00 FF"	光标-向上 数据增减	WR0295
"01 10 02 01 96 00 FF"	光标-向下 数据增减	WR0296
"01 10 02 01 97 00 FF"	光标-向左 光标移动	WR0297
"01 10 02 01 98 00 FF"	光标-向右 光标移动	WR0298
"01 10 02 01 99 00 FF"	确认-OK	WR0299
"01 10 02 01 9a 00 FF"	取消-ESC	WR029A
"01 10 02 01 9b 00 FF"	启动 START<波形传输 ON 时> 测试完成-返回测试结(32B)	WR029B_01
	启动<波形传输 ON 时> 测试(采样)完成-返回测试波形(250B)	WR029B_02
	启动<波形传输 OFF 时> 测试完成-返回通道号+编号+标志(3B)	WR029B_03
"01 10 02 01 9c 00 FF"	停止 STOP 1 次终止报警声 2 次复位测试状态(复位分选)	WR029C
"01 10 02 01 9d 00 FF"	基本测试	WR029D
"01 10 02 01 9e 00 FF"	快速探查	WR029E
"01 10 03 10 00 FF"	写当前系统设置参数(16B) [4]有效 0x80[5]编号 0~99	WR0303
"01 10 04 40 00 FF"	写当前测试标准参数(64B) [4]有效 0x80[5]编号 0~99	WR0403
"01 10 05 fa 00 FF"	写当前测试标准波形(250B) [4]有效 0x80[5]编号 0~99	WR0503
"01 10 06 40 00 FF"	写存储区标准参数(64B) [4]有效 0x80[5]编号 0~99	WR06xx
"01 10 07 fa 00 FF"	写存储区标准波形(250B) [4]有效 0x80[5]编号 0~99	WR07xx

4.0 参数区内容详解


4.1 系统参数

序号	HEX	说 明	数值范围	备 注
0	80	0x80 编号有效 0x00 编号无效	0x80/0x00	
1	00	当前测试现场编号 0~99	0~99	
2	00	网格模式: 0 标准网格 1 零位线 2 无网格 3 密密网格	0~3	
3	00	声响模式: 0 不合格响 1 合格响 2 静音	0~2	
4	00	判断模式: 0 不合格终止 1 不合格继续	0~1	
5	00	测试模式: 0 单绕组 NORMAL 1 三相四线 AUTO3Y 2 三相三线 AUTO3V 3 两组三线 AUTOS2 4 三组四线 AUTOS3 5 三组三线 AUTOAB	0~5	YG212S 专用
6	01	按键声音: 0 关闭 1 打开	0~1	
7	00	语言选择: 0 中文 1 英文	0~1	
8	01	设备地址: 1~99	1~99	
9	00	波特率: 0-9600 1-19200 2-38400 3-57600	0~3	
10	00	校验模式: 0 无校验 1 异或校验 2 累加和校验 3 CRC	0~3	
11	00	波形传输: 0 关闭(可被动读取) 1 打开(主动发送)	0~1	
12	00	备用		
13	00	备用		
14	00	备用		
15	00	备用		

4.2 测试波形

X 轴: 0~249 地址

Y 轴: 接收到的数据(值域 0~255) 零位线数据 128

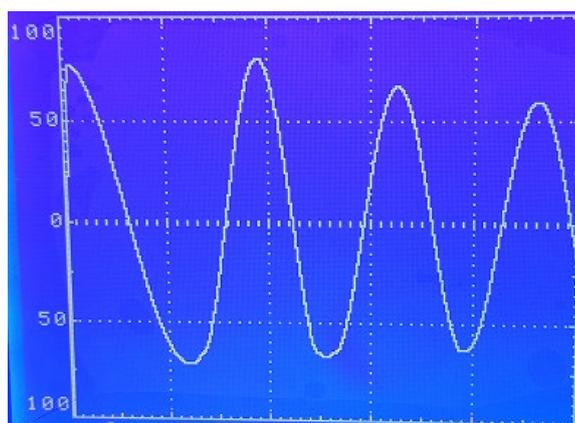

0 50 100 150 200 250

通道对应: AUTO3Y / AUTOS3 模式: 0 通道 (AG) / 1 通道 (BG) / 2 通道 (CG) AUTO3V / AUTOAB

模式: 0 通道 (AB) / 1 通道 (BC) / 2 通道 (CA) AUTOS2 模式: 0 通道 (AG) / 1 通道 (BG)

4.3 测试参数

序号	HEX	说 明	数值范围	备 注
0	80	0x80 编号有效 0x00 编号无效	0x80/0x00	
1	00	编号 当前测试现场编号 0~99	0~99	
2	1d	名称[7] 显示时查表转 ASCII 码	查表： "012345678 9ABCDEFGHI JKLMNOPQRS TUVWXYZabc defghijklm nopqrstuvw xyz_./ " "	查表
3	2f	名称[6] 显示时查表转 ASCII 码		
4	00	名称[5] 显示时查表转 ASCII 码		
5	00	名称[4] 显示时查表转 ASCII 码		
6	00	名称[3] 显示时查表转 ASCII 码		
7	00	名称[2] 显示时查表转 ASCII 码		
8	00	名称[1] 显示时查表转 ASCII 码		
9	01	名称[0] 显示时查表转 ASCII 码		
10	0a	脉冲电压 (5~50)*100V		
11	01	采样频率 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 255	1~255	16 档
12	01	测试脉冲 1~16 16 为连续	1~16	
13	00	面积比较-起点 0 0~249 必须小于终点	0~249	
14	fa	面积比较-终点 250 1~250 必须大于起点	1~250	
15	0a	面积比较-限值 10 0~99	0~99	
16	01	面积比较-许可 0 关闭 1 打开	0~1	
17	00	积差比较-起点 0 0~249 必须小于终点	0~249	
18	fa	积差比较-终点 250 1~250 必须大于起点	1~250	
19	0f	积差比较-限值 15 0~99	0~99	
20	01	积差比较-许可 0 关闭 1 打开	0~1	
21	40	电晕比较-起点 64 0~249 一般选第二个峰值两侧	0~249	
22	80	电晕比较-终点 128 1~250 一般选第二个峰值两侧	1~250	
23	14	电晕比较-限值 20	0~99	
24	00	电晕比较-许可 0 关闭 1 打开	0~1	
25	02	相位比较-起点 2 1~6 一般选第二个过零点	1~6	
26	05	相位比较-限值 5 0~50	0~50	
27	00	相位比较-许可 0 关闭 1 打开	0~1	
28	28	波形幅度 (5~50)*4 对应脉冲电压基数*4	20~200	
29	00	音圈极性-标准 0 + 1 -	0~1	P 型专用
30	00	音圈极性-许可 0 关闭 1 打开	0~1	P 型专用
31	00	消磁脉冲 0~16	0~16	
32	00	备用		
.....	备用		
41	00	波形选择 0~15 查表对应采样频率值	0~15	
.....		
63	00	备用		

5.0 错误信息详解

5.1 读取错误信息

PC 机接收 指令串	说 明	
"01 83 01 01 01 00 FF"	读设备信息	读取指令错误
"01 83 02 01 01 00 FF"	读当前被测结果、波形 (250B)	读取指令错误
"01 83 03 01 01 00 FF"	读当前系统设置参数 (16B)	读取指令错误
"01 83 04 01 01 00 FF"	读当前测试标准参数 (64B)	读取指令错误
"01 83 05 01 01 00 FF"	读当前测试标准波形 (250B)	读取指令错误
"01 83 06 01 01 00 FF"	读 0~99 读存储区标准参数 (64B)	读取指令错误
"01 83 06 01 02 00 FF"		编号超限
"01 83 06 01 03 00 FF"		编号参数无效
"01 83 07 01 01 00 FF"	读波形区 0~99 读存储区标准波形 (250B)	读取指令错误
"01 83 07 01 02 00 FF"		编号超限
"01 83 07 01 03 00 FF"		编号参数无效

5.2 写入错误信息

5.2.1 系统参数错误信息

PC 机接收 指令串	说 明	
"01 90 01 01 01 00 FF"	仪器 0xff 初始化(慎用) 仪器 0xfe 热复位	指令错误
"01 90 02 01 01 00 FF"	内部操作指令	指令错误
"01 90 02 01 02 00 FF"	加载 0~99 测试参数 xx 编号 0~99	编号错误
"01 90 02 01 03 00 FF"	加载 效	编号参数无
"01 90 02 01 04 00 FF"	删除 1~99 测试参数 xx 编号 1~99	编号错误
"01 90 02 01 05 00 FF"	删除 效	编号参数无
"01 90 03 01 01 00 FF"	错误 01-编号参数无效	
"01 90 03 01 02 00 FF"	错误 02-当前编号超限 0~99	
"01 90 03 01 03 00 FF"	错误 03-网格模式 0 标准网格 1 零位线 2 无网格 3 密密网格	
"01 90 03 01 04 00 FF"	错误 04-声响模式 0 不合格响 1 合格响 2 静音	
"01 90 03 01 05 00 FF"	错误 05-判断模式 0 不合格终止 1 不合格继续	
"01 90 03 01 06 00 FF"	错误 06-测试模式 0 单绕组 NORMAL 1 三相四线 AUTO3Y 2 三相三线 AUTO3V 3 单相 2 组 AUTOS2 4 单相 3 组 AUTOS3 5 单相 3 线 AUTOAB	
"01 90 03 01 07 00 FF"	错误 07-按键声音 0 关闭 1 打开	
"01 90 03 01 08 00 FF"	错误 08-语言选择 0 中文 1 英文	
"01 90 03 01 09 00 FF"	错误 09-设备地址 1~99	
"01 90 03 01 0a 00 FF"	错误 10-波特率 0-9600 1-19200 2-38400 3-57600	
"01 90 03 01 0b 00 FF"	错误 11-校验模式 0 无校验 1 异或校验 2 累加和校验 3 CRC	
"01 90 03 01 0c 00 FF"	错误 12-波形传输 0 关闭 1 打开	
"01 90 03 01 0d 00 FF"		
"01 90 04 01 03 00 FF"	写当前测试标准参数(64B)	
"01 90 05 01 03 00 FF"	写当前测试标准波形(250B)	
"01 10 06 01 xx 00 FF"	写存储区标准参数(64B) xx 编号 0~99	
"01 10 07 01 xx 00 FF"	写存储区标准波形(250B) xx 编号 0~99	

5.2.2 写当前测试标准参数或写存储区标准参数 错误信息

HEX	说 明	数值范围	备 注
"01 90 04 01 01 00 FF"	错误 01-0x80 编号有效 0x00 编号无效	0x80/0x00	
"01 90 04 01 02 00 FF"	错误 02-编号 当前测试现场编号 0~99	0~99	
	名称[7..0] 显示时查表转 ASCII 码	"012345678 9ABCDEFGHI JKLMNOPQRS TUVWXYZabc defghi jklm nopqrstuvw xyz_./-/"	
"01 90 04 01 0b 00 FF"	错误 11-脉冲电压 (5~50)*100V	5~50	倍率 100
"01 90 04 01 0c 00 FF"	错误 12-采样频率 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 255	1~255	16 档
"01 90 04 01 0d 00 FF"	错误 13-测试脉冲 1~16 16 为连续	1~16	
"01 90 04 01 0e 00 FF"	错误 14-面积比较-起点 0 0~249 必须小于终点	0~249	
"01 90 04 01 0f 00 FF"	错误 15-面积比较-终点 250 1~250 必须大于起点	1~250	
"01 90 04 01 10 00 FF"	错误 16-面积比较-限值 10 0~99	0~99	
"01 90 04 01 11 00 FF"	错误 17-面积比较-许可 0 关闭 1 打开	0~1	
"01 90 04 01 12 00 FF"	错误 18-积差比较-起点 0 0~249 必须小于终点	0~249	
"01 90 04 01 13 00 FF"	错误 19-积差比较-终点 250 1~250 必须大于起点	1~250	
"01 90 04 01 14 00 FF"	错误 20-积差比较-限值 15 0~99	0~99	
"01 90 04 01 15 00 FF"	错误 21-积差比较-许可 0 关闭 1 打开	0~1	
"01 90 04 01 16 00 FF"	错误 22-电晕比较-起点 64 0~249 常选峰值两侧	0~249	
"01 90 04 01 17 00 FF"	错误 23-电晕比较-终点 128 1~250 常选峰值两侧	1~250	
"01 90 04 01 18 00 FF"	错误 24-常电晕比较-限值 20	0~99	
"01 90 04 01 19 00 FF"	错误 25-电晕比较-许可 0 关闭 1 打开	0~1	
"01 90 04 01 1a 00 FF"	错误 26-相位比较-起点 2 1~6 常选第二过零点	1~6	
"01 90 04 01 1b 00 FF"	错误 27-相位比较-限值 5 0~50	0~50	
"01 90 04 01 1c 00 FF"	错误 28-相位比较-许可 0 关闭 1 打开	0~1	
"01 90 04 01 1d 00 FF"	错误 29-波形幅度(5~50)*4 对应脉冲电压基数*4	20~200	
"01 90 04 01 1e 00 FF"	错误 30-音圈极性-标准 0 + 1 -	0~1	
"01 90 04 01 1f 00 FF"	错误 31-音圈极性-许可 0 关闭 1 打开	0~1	
"01 90 04 01 20 00 FF"	错误 32-消磁脉冲 0~16	0~16	
"01 90 04 01 21 00 FF"	备用		
.....		
"01 90 04 01 2a 00 FF"	错误 42-波形选择 0~15 对应采样频率 16 档	0~15	
.....		
"01 90 04 01 11 00 FF"	备用		

说明：写存储区(0x06)标准参数 错误信息 与 写当前测试(0x04)标准参数 信息内容对应